

MEDVIE


Date du test: 29/03/2024 10:54:02

Durée: 8mn 27s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		SAGNO MIMI
Date de naissance	01/01/1989	
Age	35	
Société	BCEIP	
ID	24032910452312912	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

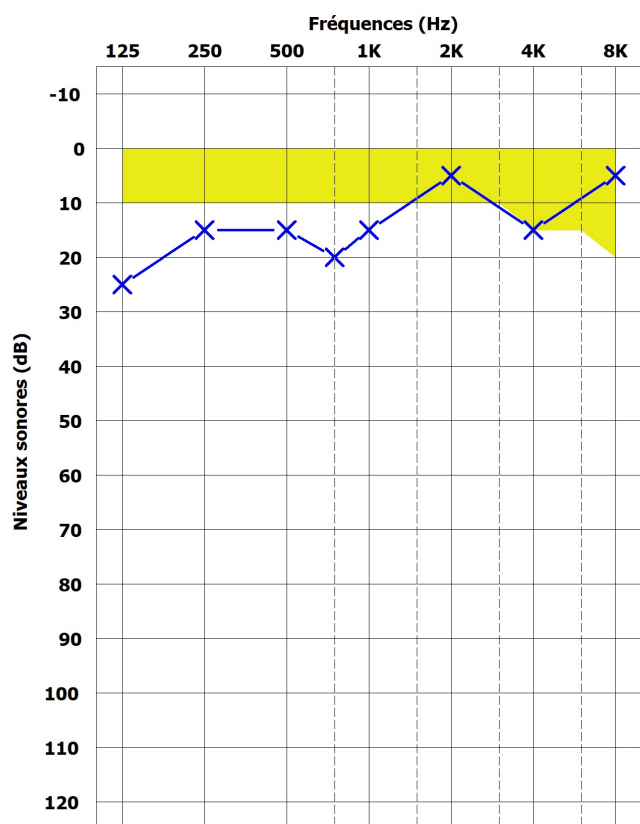

Oreille Gauche

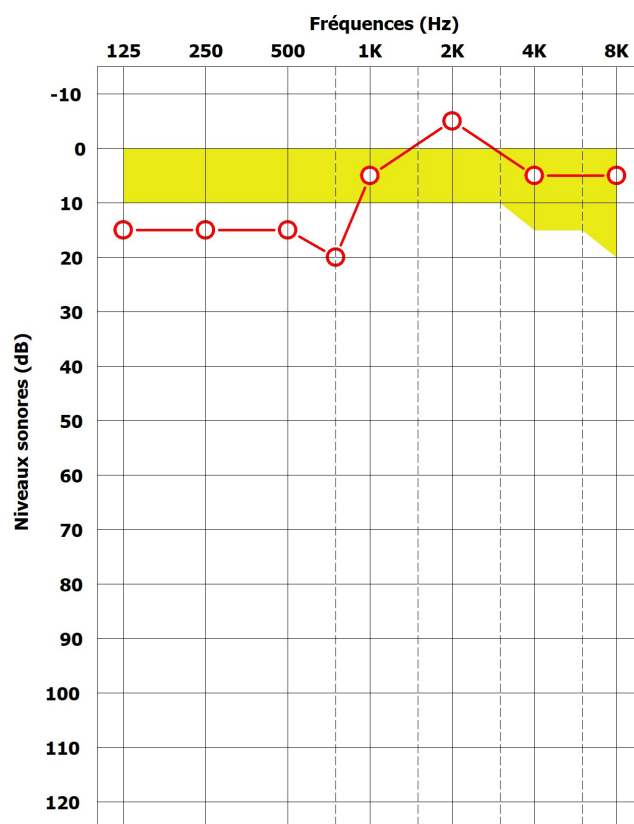

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	15	15	20	15		5		15		5
CA Droit	15	15	15	20	5		-5		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes