

MEDVIE


Date du test: 06/05/2024 17:27:29

Durée: 5mn 05s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   |                   |
|-------------------|-------------------|
| SOUMAORO LANCINE  |                   |
| Date de naissance | 01/08/1990        |
| Age               | 33                |
| Société           | BCEIP/293         |
| ID                | 24050617251579426 |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

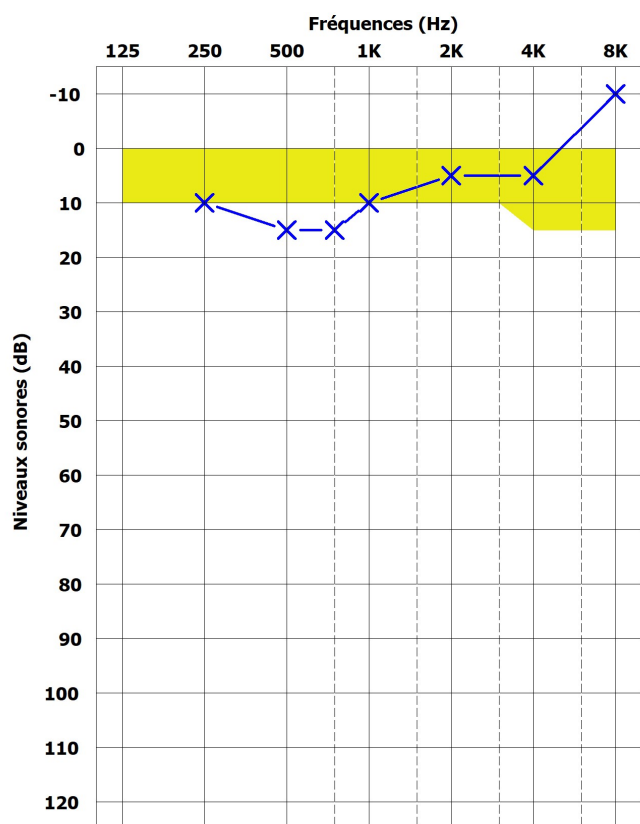

Oreille Gauche

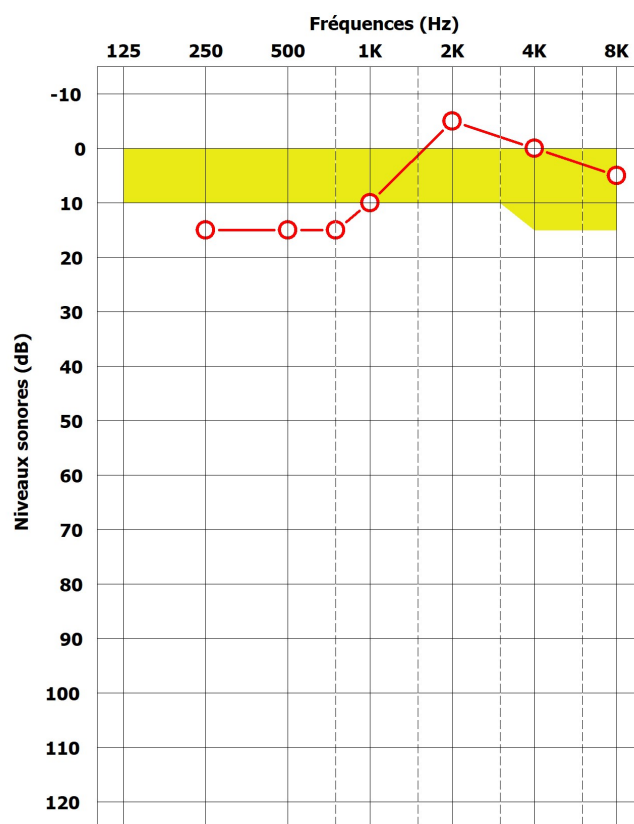

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k  |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|
| CA Gauche |     | 10  | 15  | 15  | 10 |     | 5  |    | 5  |    | -10 |
| CA Droit  |     | 15  | 15  | 15  | 10 |     | -5 |    | 0  |    | 5   |

| Calcul de perte | PAM    | IPA |
|-----------------|--------|-----|
| CA Gauche       | 8,8 dB | --- |
| CA Droit        | 5,0 dB | --- |

Notes