


MEDVIE


Date du test: 29/03/2024 14:09:33
Durée: 10mn 25s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KAMANO ROBERT	
Date de naissance	01/01/1985
Age	39
Société	BCEIP
ID	24032914064946731

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

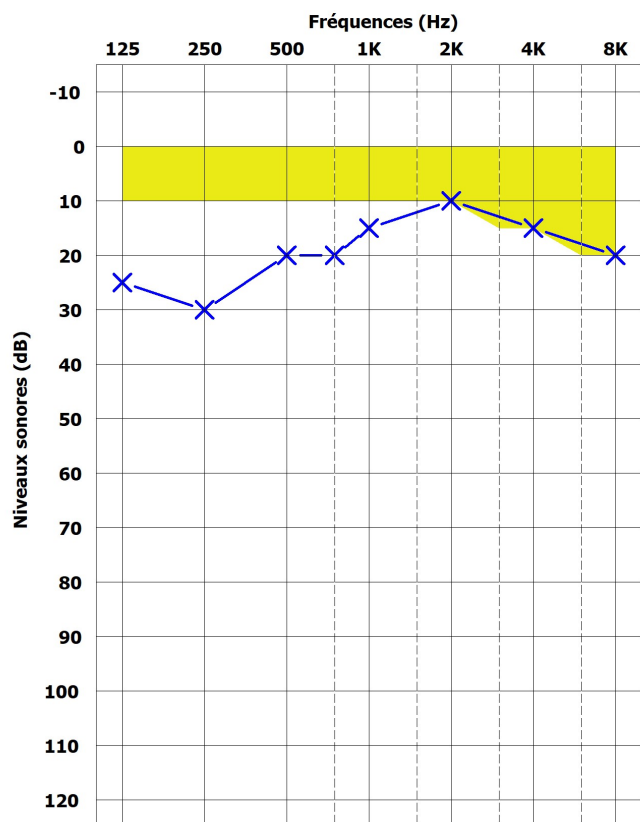

Oreille Gauche

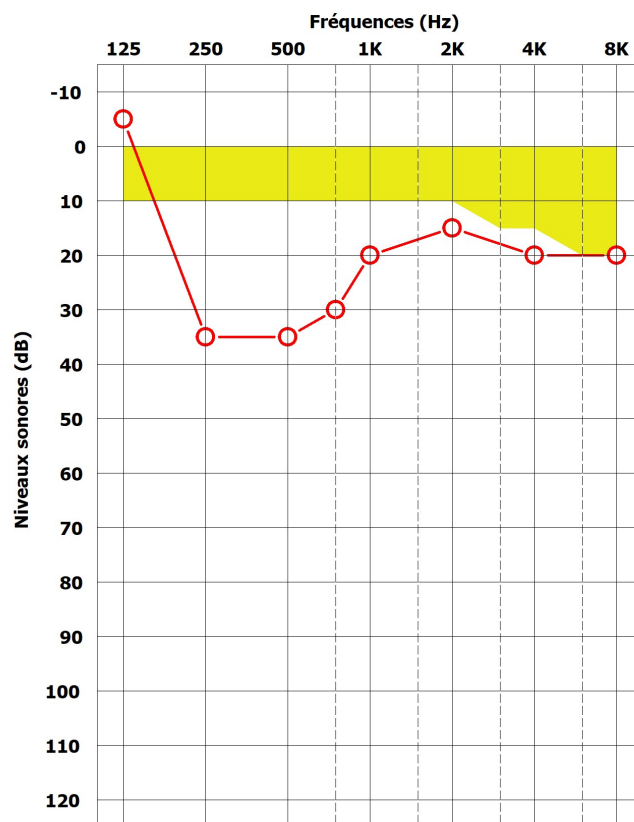

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	30	20	20	15		10		15		20
CA Droit	-5	35	35	30	20		15		20		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes