

MEDVIE


Date du test: 08/07/2024 14:06:32

Durée: 6mn 19s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SOUMAORO MOUSSA	
Date de naissance	01/01/1994
Age	30
Société	BCEIP
ID	24070814035080667

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

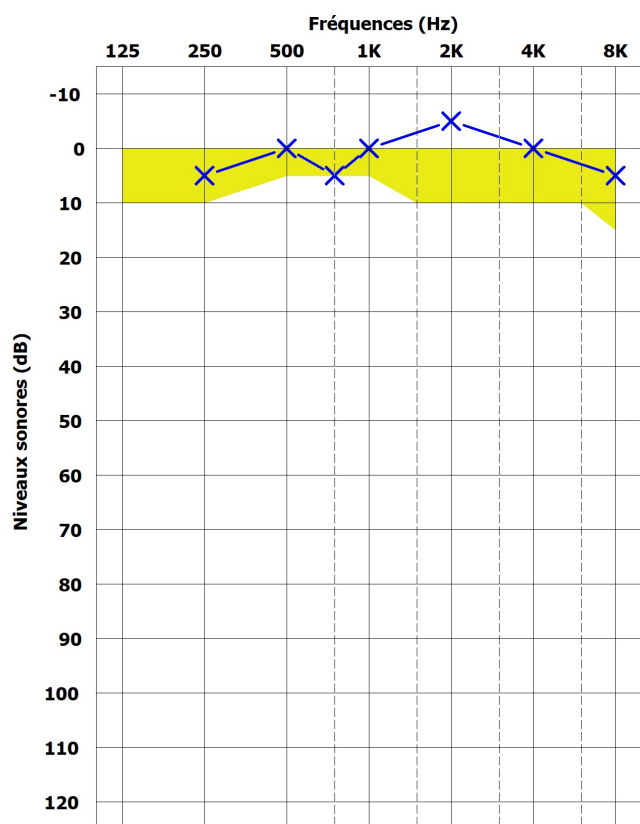

Oreille Gauche

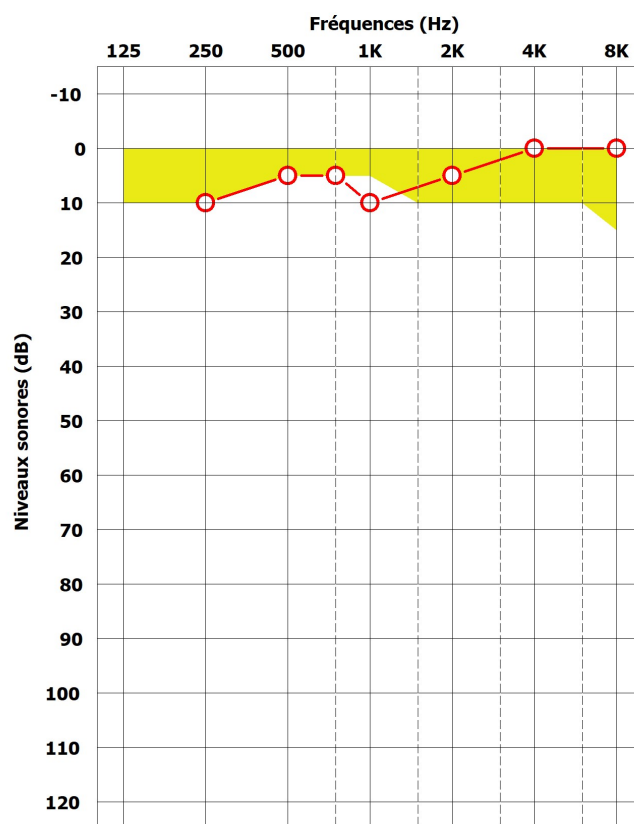

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	0	5	0		-5		0		5
CA Droit		10	5	5	10		5		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	-1,3 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes