


MEDVIE


Date du test: 31/05/2024 12:22:46

Durée: 4mn 16s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

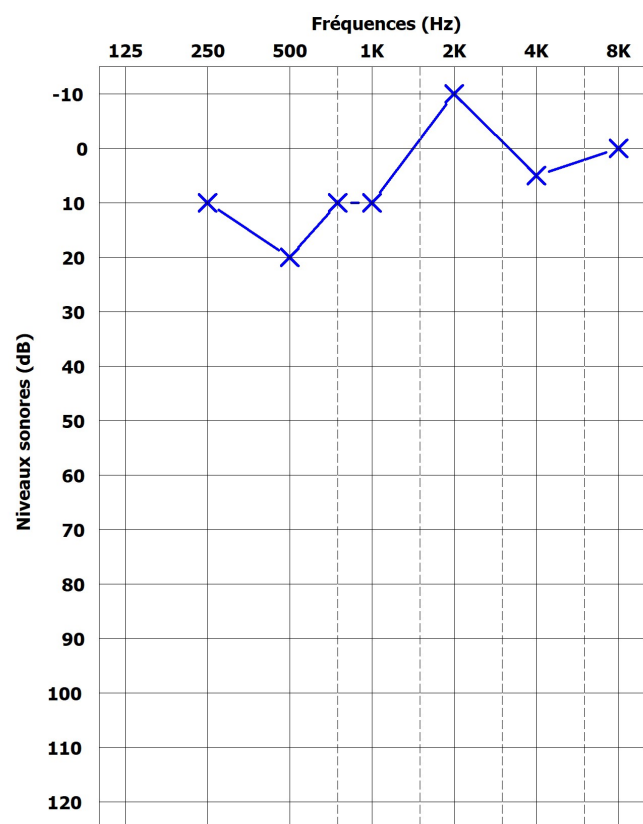

Oreille Gauche

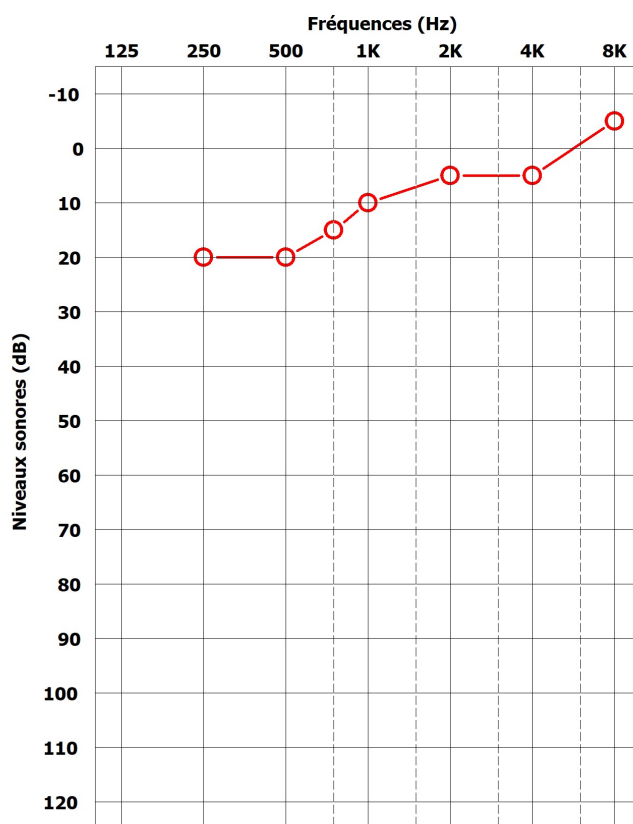

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	20	10	10		-10		5		0
CA Droit		20	20	15	10		5		5		-5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes

Données Patient	CAMARA MAMADY
Date de naissance	01/01/1994
Age	30
Société	MV/BCEIP
ID	24053112113541541

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021