

MEDVIE


Date du test: 07/05/2024 14:58:00

Durée: 4mn 21s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	BERETE YOUSOUF
Date de naissance	01/01/1995
Age	29
Société	BCEIP
ID	24050714460904494

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

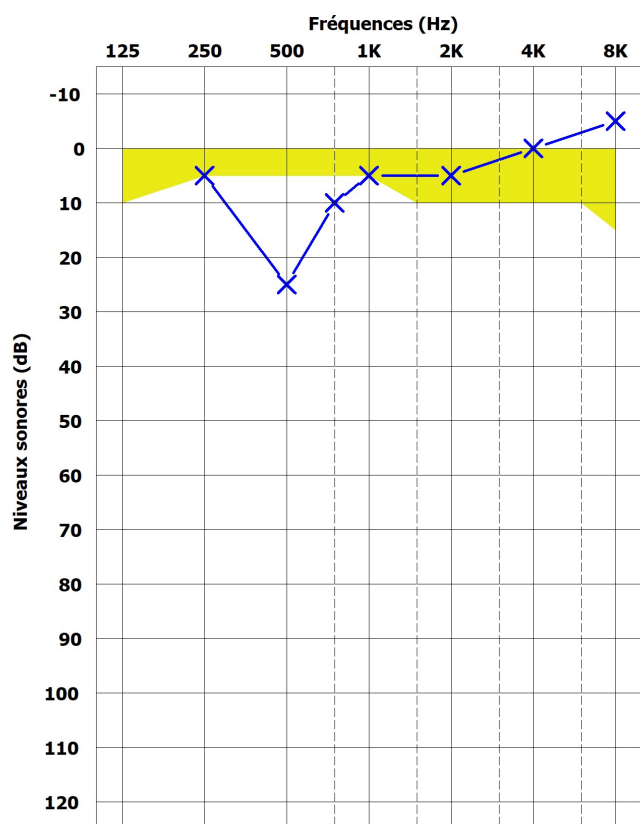

Oreille Gauche

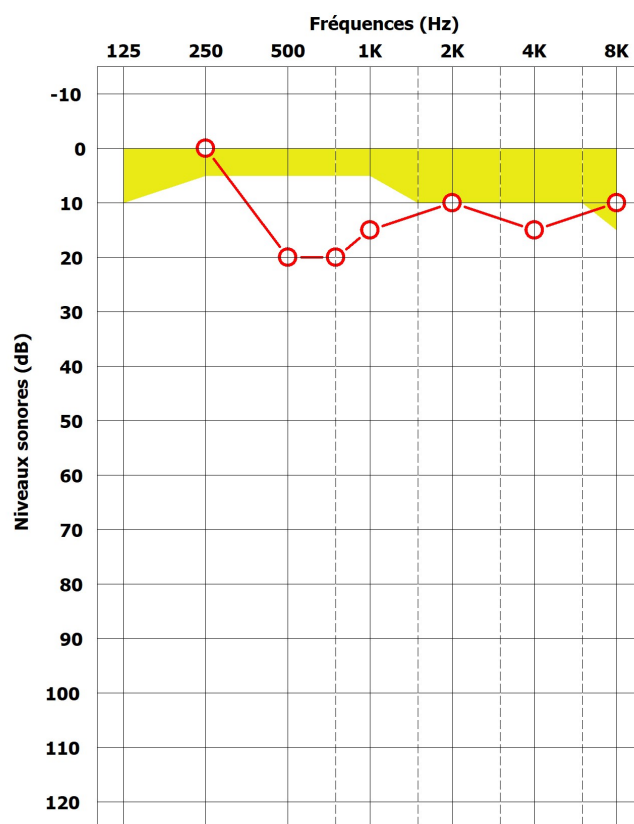

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	25	10	5		5		0		-5
CA Droit		0	20	20	15		10		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes