

MEDVIE

Date du test: 28/03/2024 10:22:15

Durée: 8mn 36s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

CISSOKO MORY

Date de naissance

01/01/1994

Age

30

Société

BCEIP

ID

24032810195607469

Audiomètre

Type:


Audio 820M V2,211

Numéro de série:


2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021

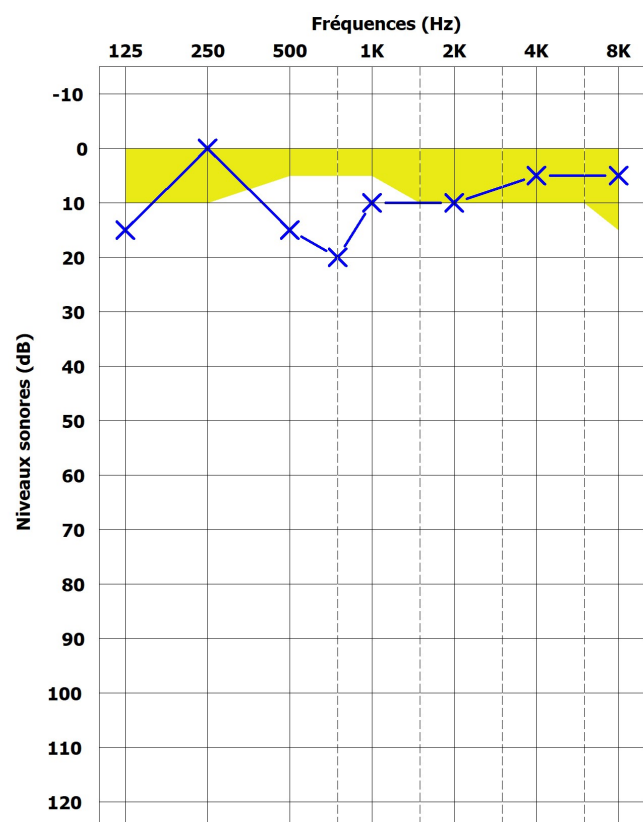

Oreille Gauche

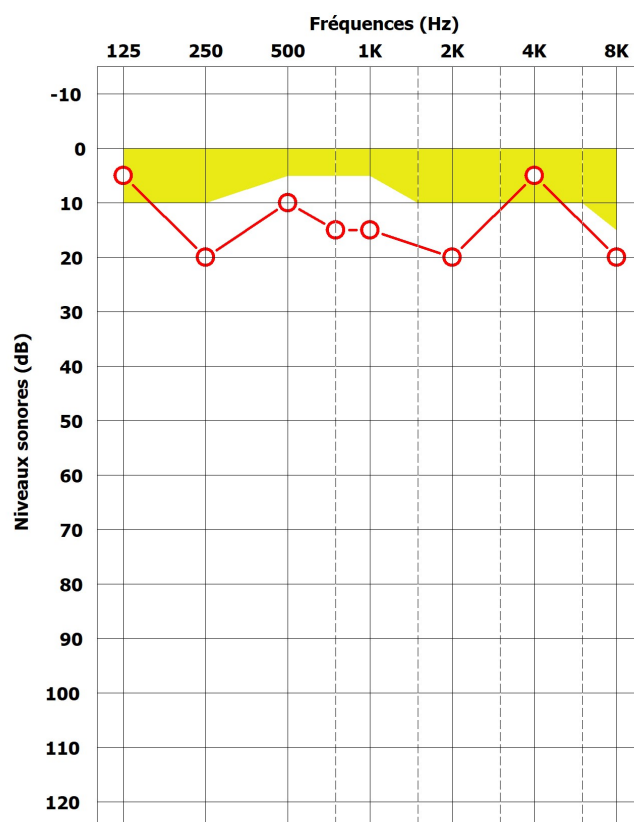

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	0	15	20	10		10		5		5
CA Droit	5	20	10	15	15		20		5		20

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes