


MEDVIE


Date du test: 05/07/2024 15:52:22

Durée: 5mn 47s

Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

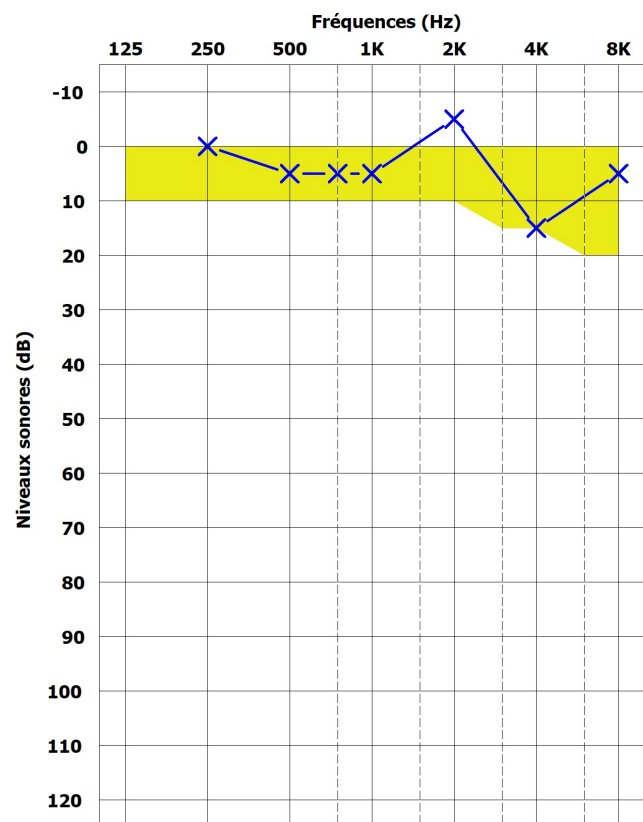

Oreille Gauche

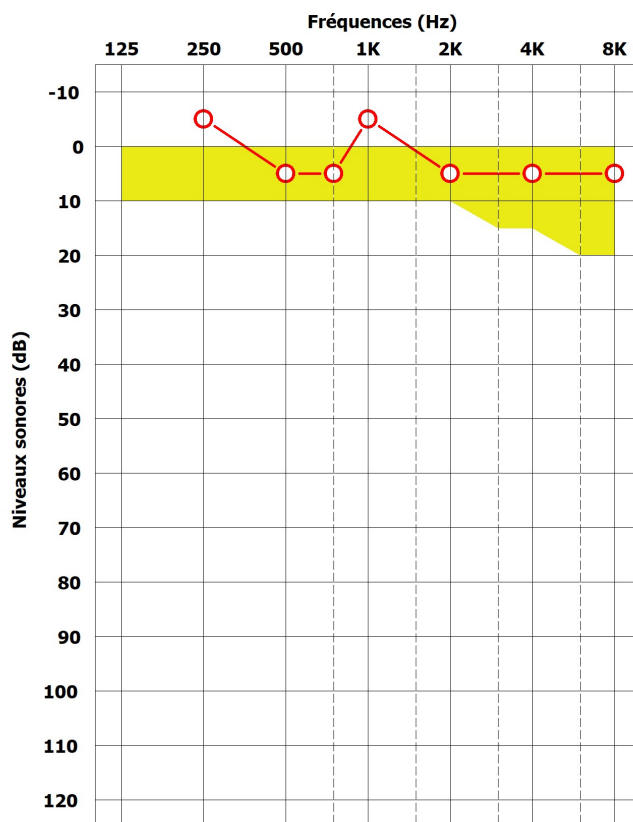

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 0   | 5   | 5   | 5  |     | -5 |    | 15 |    | 5  |
| CA Droit  |     | -5  | 5   | 5   | -5 |     | 5  |    | 5  |    | 5  |

| Calcul de perte | PAM    | IPA |
|-----------------|--------|-----|
| CA Gauche       | 5,0 dB | --- |
| CA Droit        | 2,5 dB | --- |

Notes

| Données Patient   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
|                   | <b>CAMARA</b><br><b>ARNOIRAHAMANE</b> |
| Date de naissance | 25/01/1986                            |
| Age               | 38                                    |
| Société           | BCEIP                                 |
| ID                | 24070515503897395                     |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |