

MEDVIE


Date du test: 28/03/2024 12:41:56

Durée: 7mn 25s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
FOFANA MOHAMED	
Date de naissance	01/12/1994
Age	29
Société	BCEIP
ID	24032812384976336

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

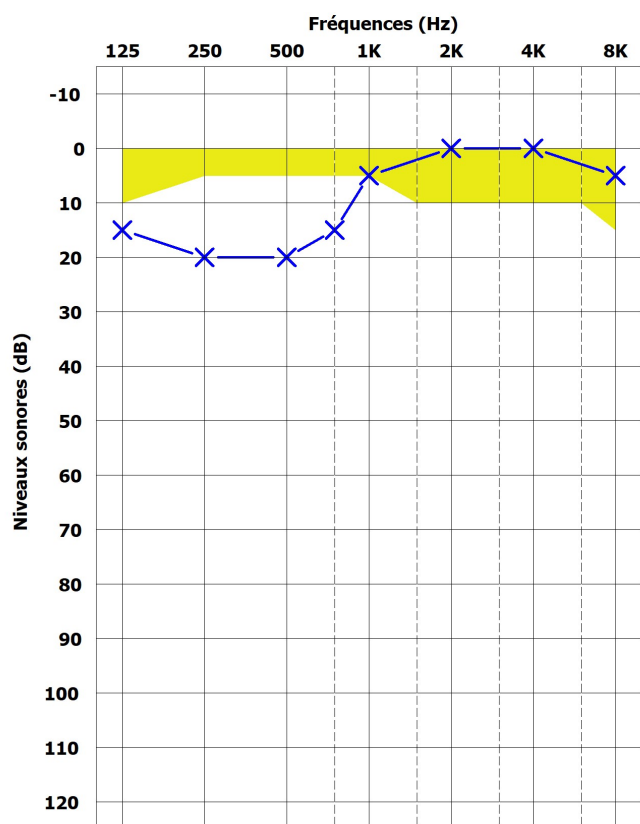

Oreille Gauche

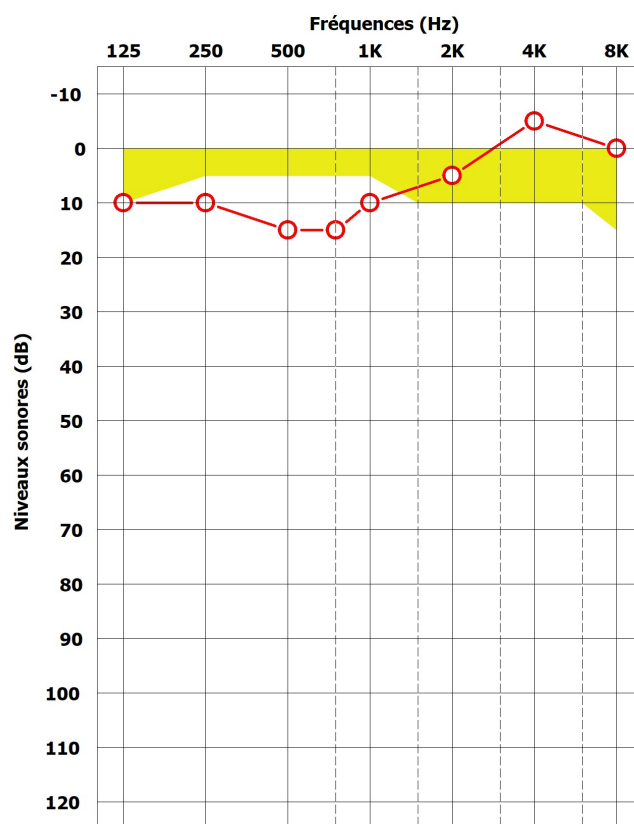

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	20	20	15	5		0		0		5
CA Droit	10	10	15	15	10		5		-5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes