

Données Patient		CAMARA MAMASI MAMASSAN
Date de naissance	07/03/2003	
Age	21	
Société	BECEIP	
ID	24100511194950083	

MEDVIE


Date du test: 05/10/2024 11:22:24

Durée: 5mn 33s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre

Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

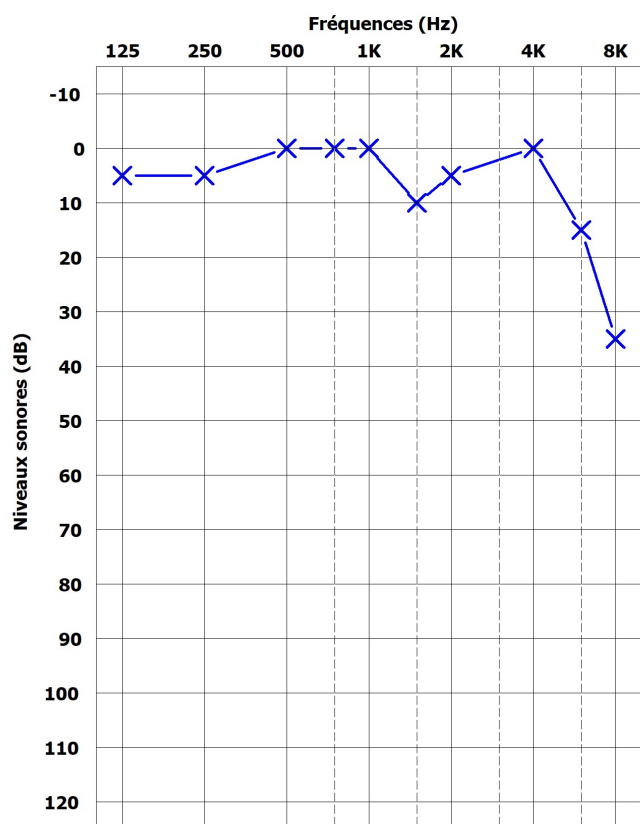

Oreille Gauche

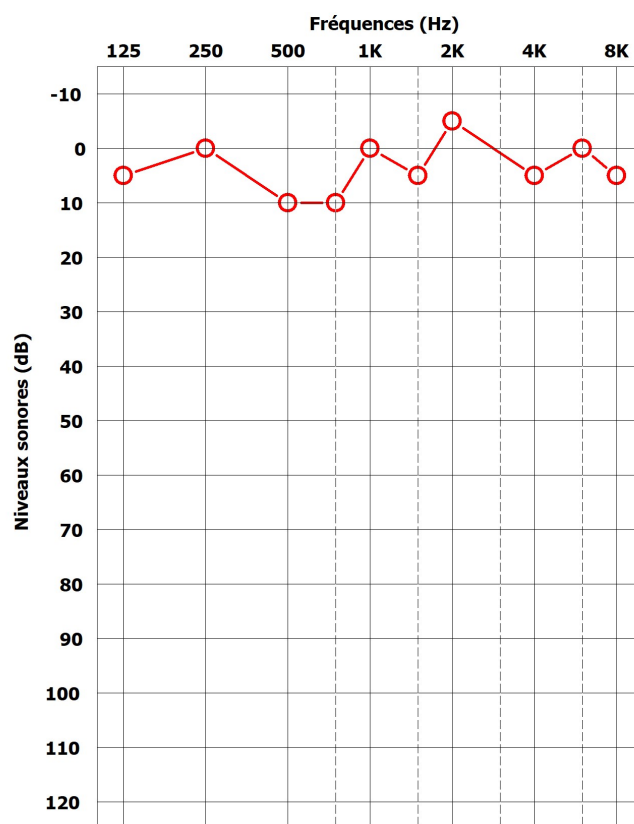

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	5	5	0	0	0	10	5		0	15	35
CA Droit	5	0	10	10	0	5	-5		5	0	5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	---	---
CA Droit	---	---

Notes