


MEDVIE


Date du test: 05/07/2024 16:01:17
Durée: 4mn 11s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		KEITA OUSLMANE
Date de naissance	01/01/1992	
Age	32	
Société	BCEIP	
ID	24070515593172549	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

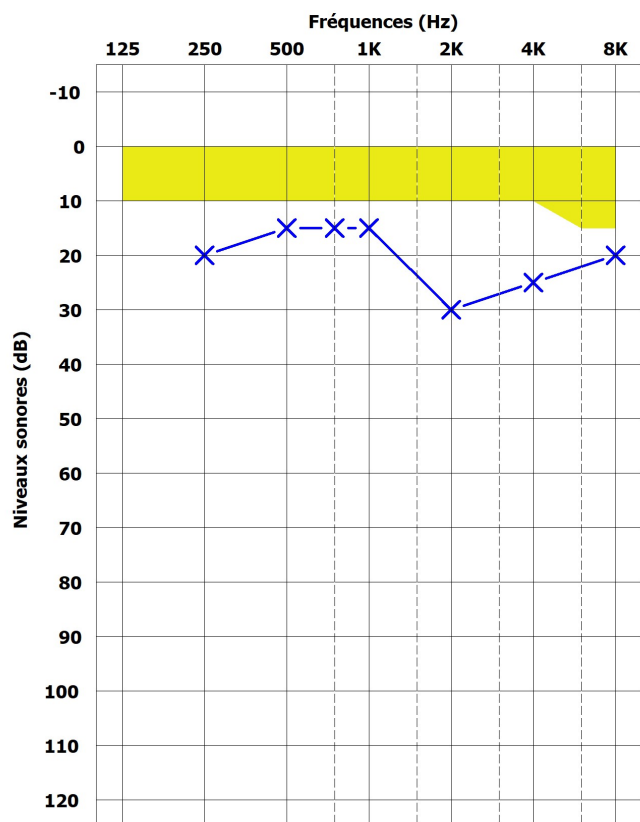

Oreille Gauche

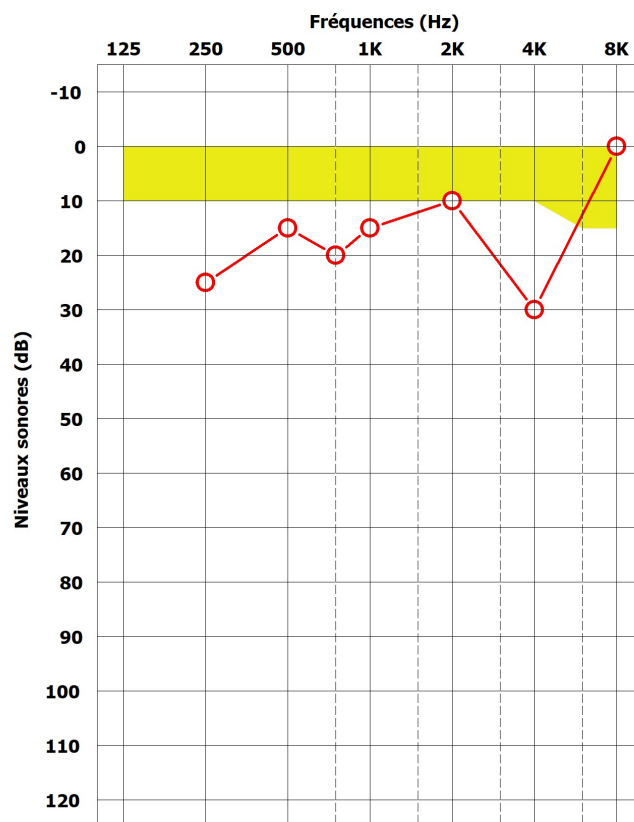

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	15	15	15		30		25		20
CA Droit		25	15	20	15		10		30		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes