

MEDVIE

Date du test: 09/08/2024 12:06:31

Durée: 4mn 30s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

SQUARE OUMAR

Date de naissance 01/01/1990

Age 34

Société BCEIP


ID 24080912045138013

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690092

Date Calibration : 30/11/2021

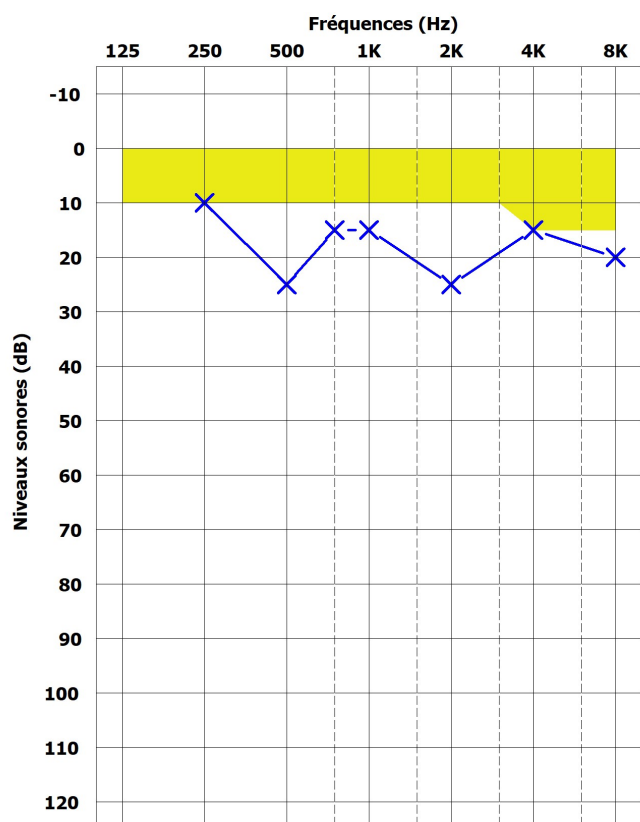

Oreille Gauche

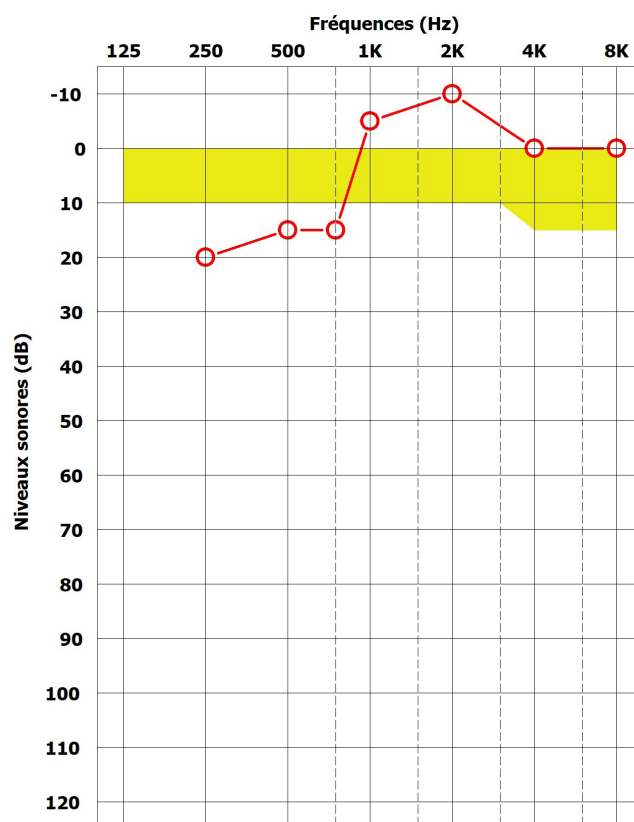

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	25	15	15		25		15		20
CA Droit		20	15	15	-5		-10		0		0

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	0,0 dB	---

Notes