


MEDVIE


Date du test: 09/08/2024 11:59:17
Durée: 4mn 00s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		BAH SIDY
Date de naissance		01/01/1993
Age		31
Société		BCEIP
ID		24080911565382173

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

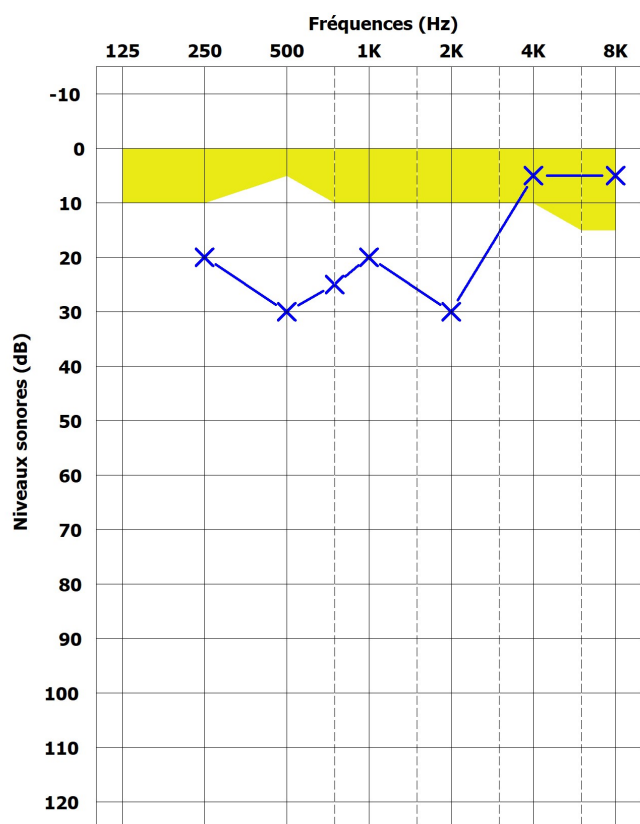

Oreille Gauche

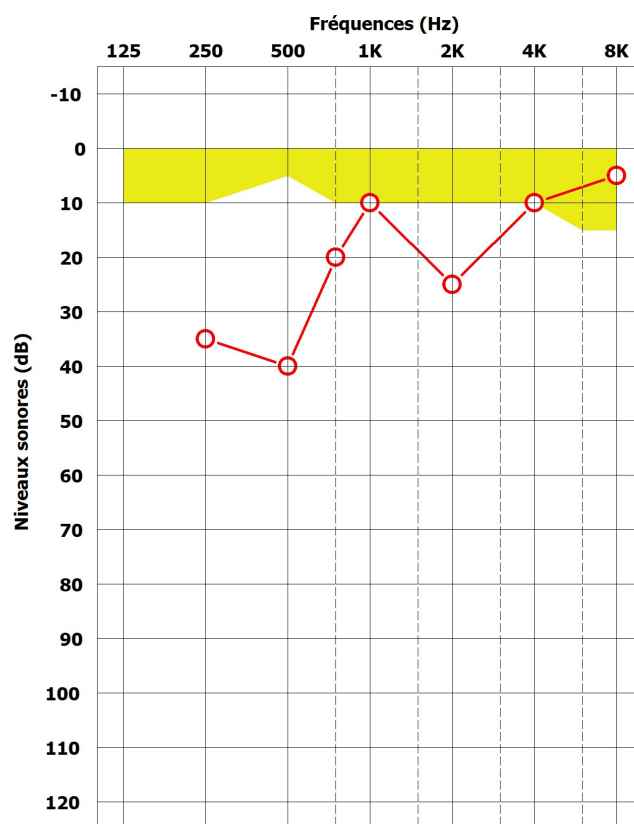

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	30	25	20		30		5		5
CA Droit		35	40	20	10		25		10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes