

MEDVIE


Date du test: 09/08/2024 12:14:25

Durée: 4mn 56s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		DIALLO MOBIDO
Date de naissance	01/01/1985	
Age	39	
Société	BCEIP	
ID	24080912115331173	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

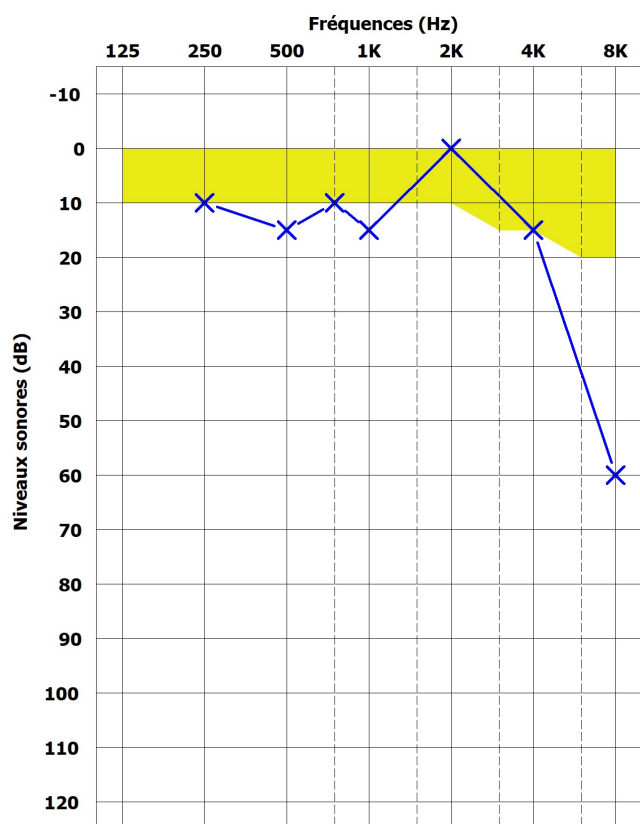

Oreille Gauche

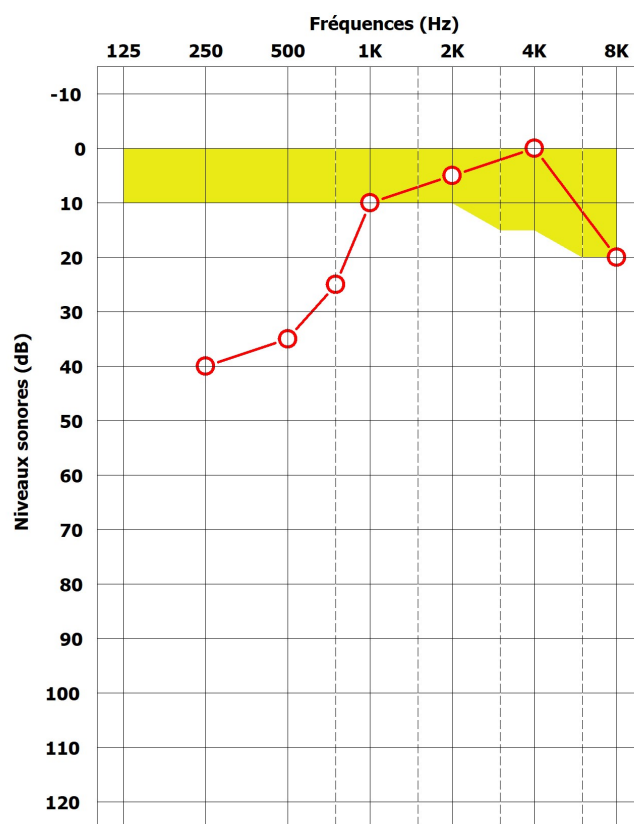

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15	10	15		0		15		60
CA Droit		40	35	25	10		5		0		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes