



Données Patient


FOFANA LAYEBA

Date de naissance 11/03/1993
Age 30
Société MV/BCEIP/50
ID 24030611224493238


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 06/03/2024 11:24:30
Durée: 4mn 17s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

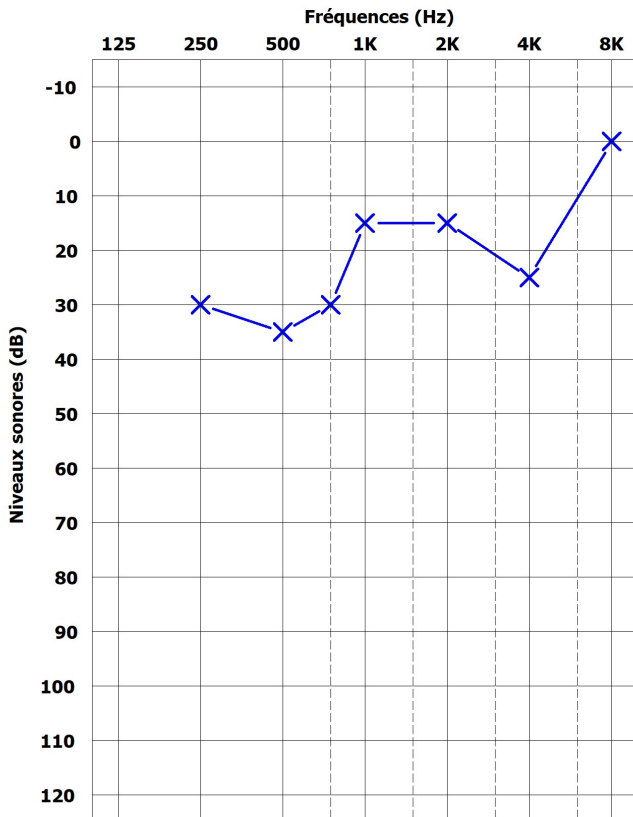

Oreille Gauche

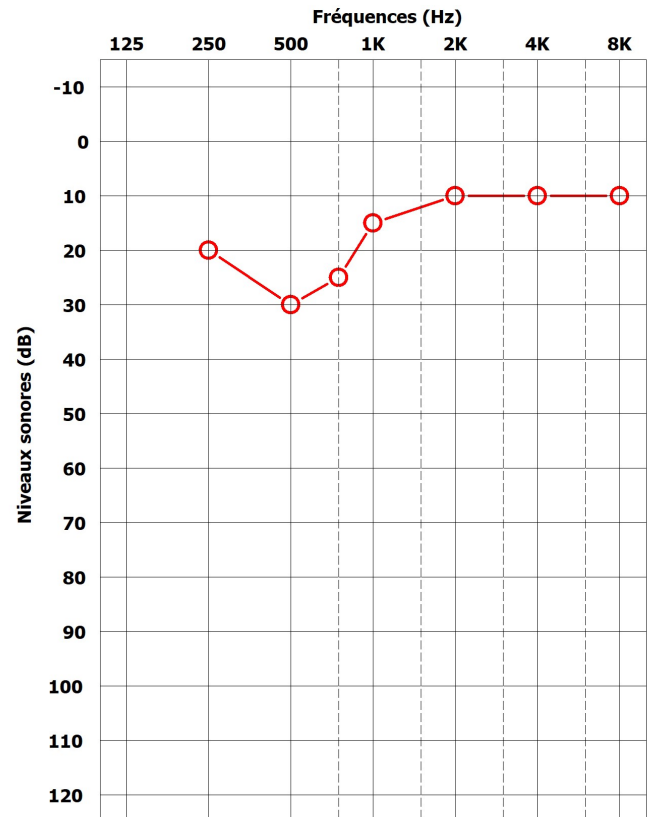

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	35	30	15		15		25		0
CA Droit		20	30	25	15		10		10		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes