


MEDVIE


Date du test: 19/04/2024 12:28:18

Durée: 8mn 35s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

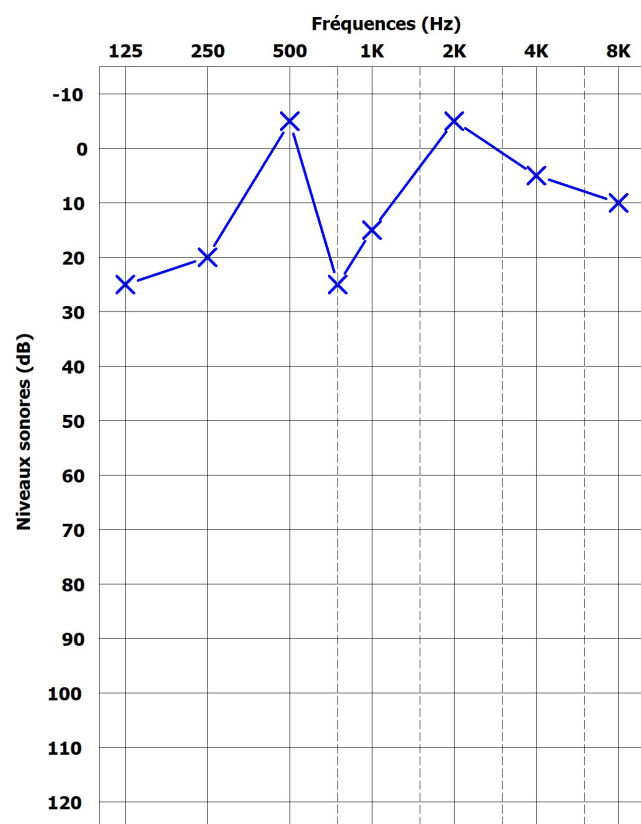

Oreille Gauche

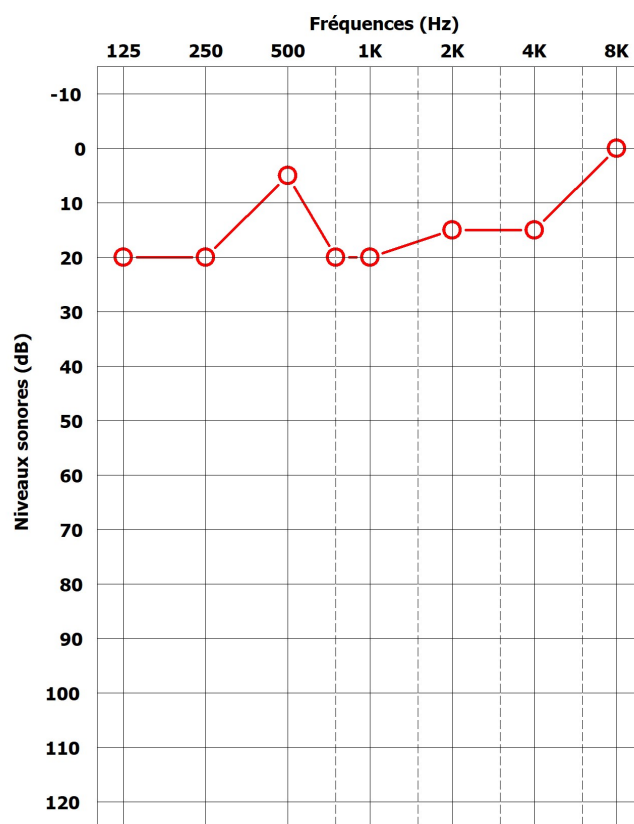

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	20	-5	25	15		-5		5		10
CA Droit	20	20	5	20	20		15		15		0

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	2,5 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes

Données Patient	TRAORE N'VACEY
Date de naissance	01/01/1976
Age	48
Société	HDS
ID	24041912184009283

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021