


MEDVIE


Date du test: 19/04/2024 11:48:32

Durée: 9mn 03s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

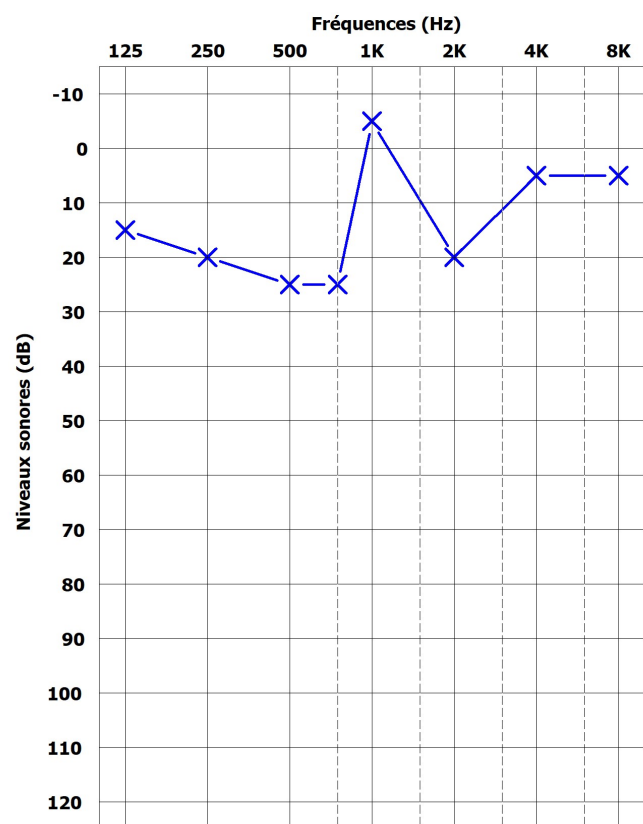

Oreille Gauche

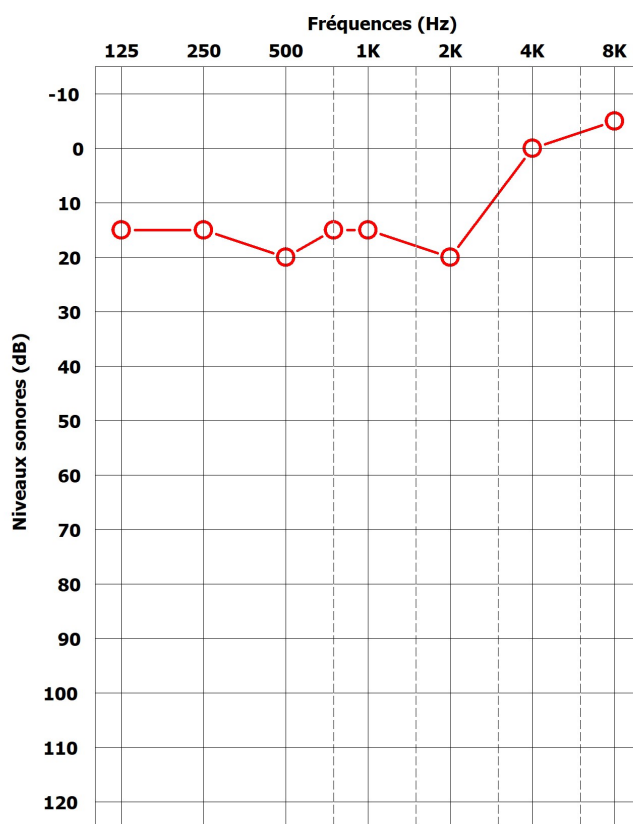

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	20	25	25	-5		20		5		5
CA Droit	15	15	20	15	15		20		0		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes

Données Patient	CHERIF MOUSSA
Date de naissance	20/06/1979
Age	44
Société	HDS
ID	24041911401435105

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021