


MEDVIE

Date du test: 21/02/2024 12:53:04

Durée: 6mn 30s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

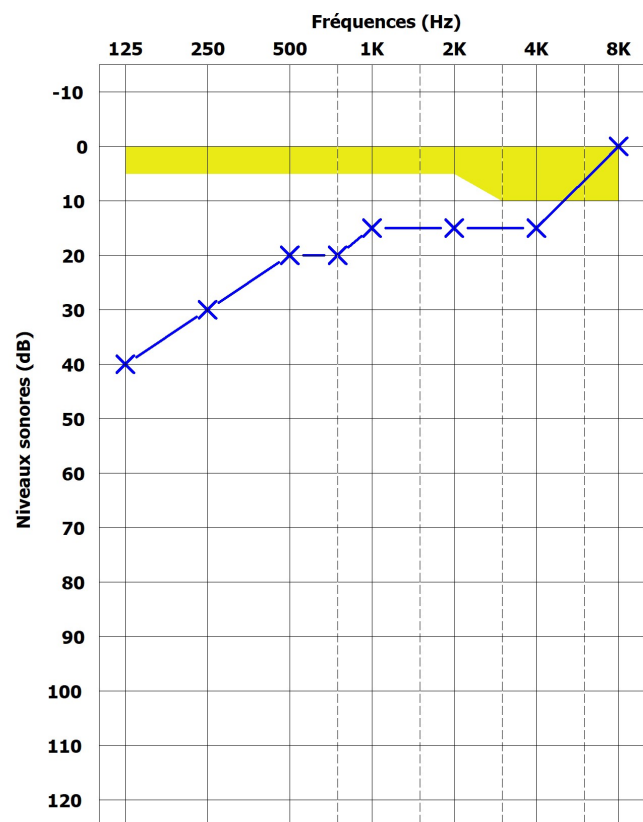

Oreille Gauche

Données Patient	
FOFANA RAMATOULAYE	
Date de naissance	18/05/1998
Age	25
Société	HDSG
ID	24022112481737538

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

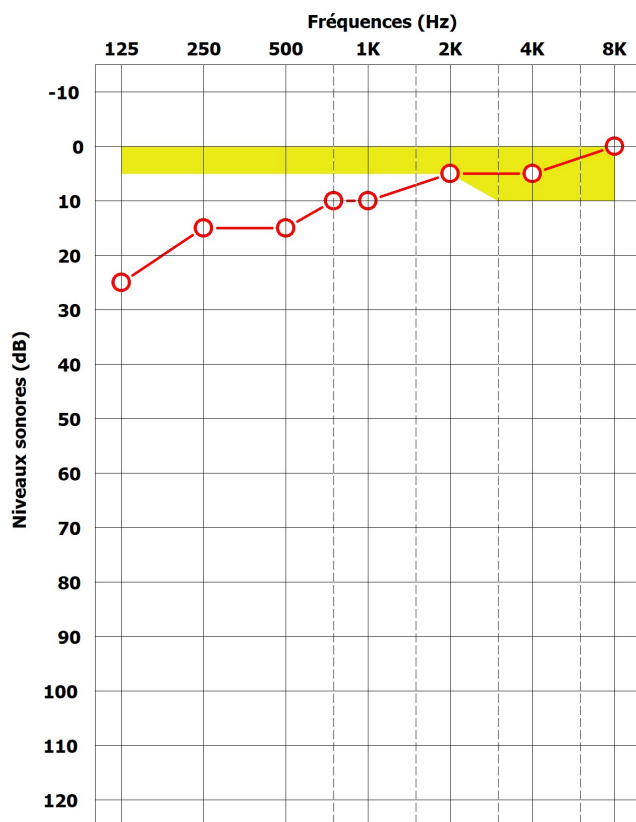

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	40	30	20	20	15		15		15		0
CA Droit	25	15	15	10	10		5		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes