


MEDVIE


Date du test: 19/04/2024 14:19:09

Durée: 9mn 01s

Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

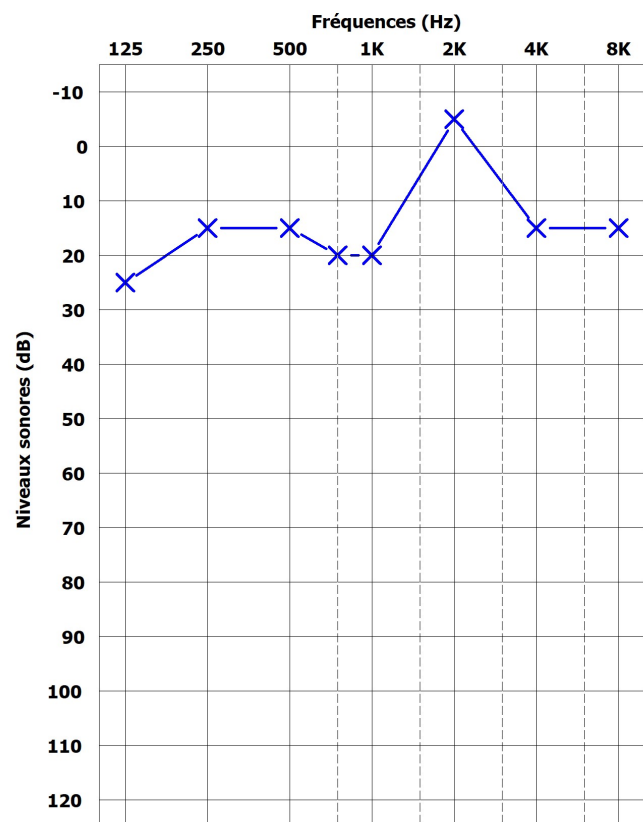

Oreille Gauche

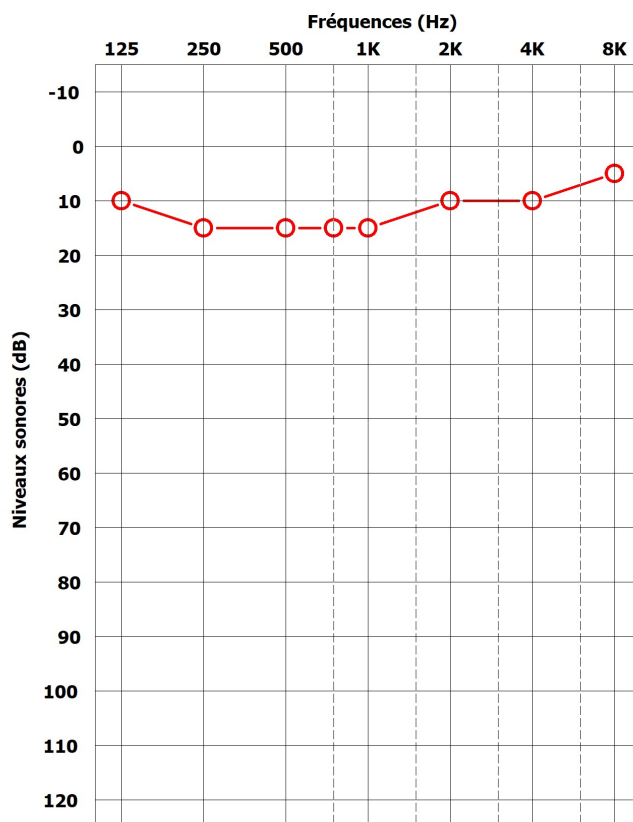

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche | 25  | 15  | 15  | 20  | 20 |     | -5 |    | 15 |    | 15 |
| CA Droit  | 10  | 15  | 15  | 15  | 15 |     | 10 |    | 10 |    | 5  |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 11,3 dB | --- |
| CA Droit        | 12,5 dB | --- |

Notes

| Données Patient   | KEÏTA ALY         |
|-------------------|-------------------|
| Date de naissance | 01/01/1990        |
| Age               | 34                |
| Société           | HDS               |
| ID                | 24041914145340636 |

| Audiomètre                     |
|--------------------------------|
| Type: Audio 820M V2,211        |
| Numéro de série: 2111EAT690093 |
| Date Calibration : 30/11/2021  |