


MED VIE


Date du test: 18/06/2024 15:17:09

Durée: 3mn 11s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

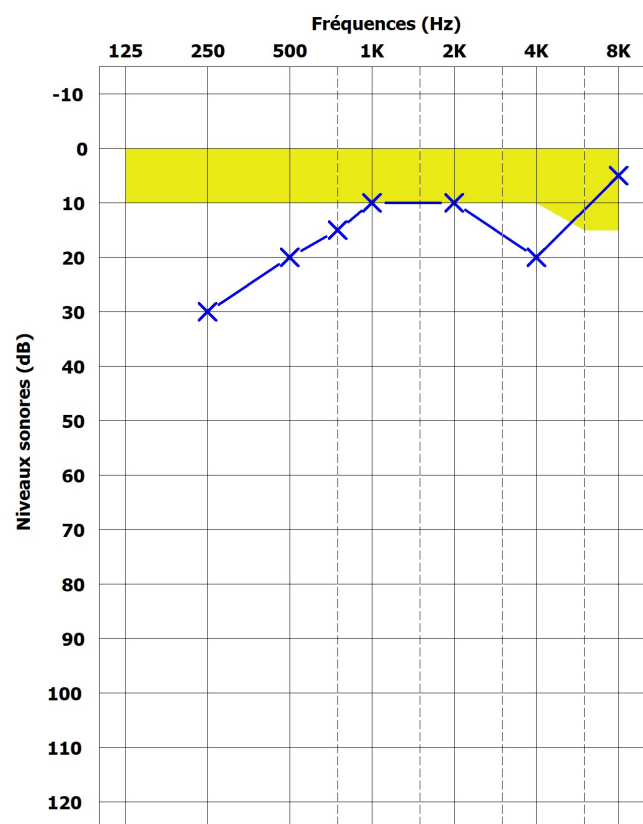

Oreille Gauche

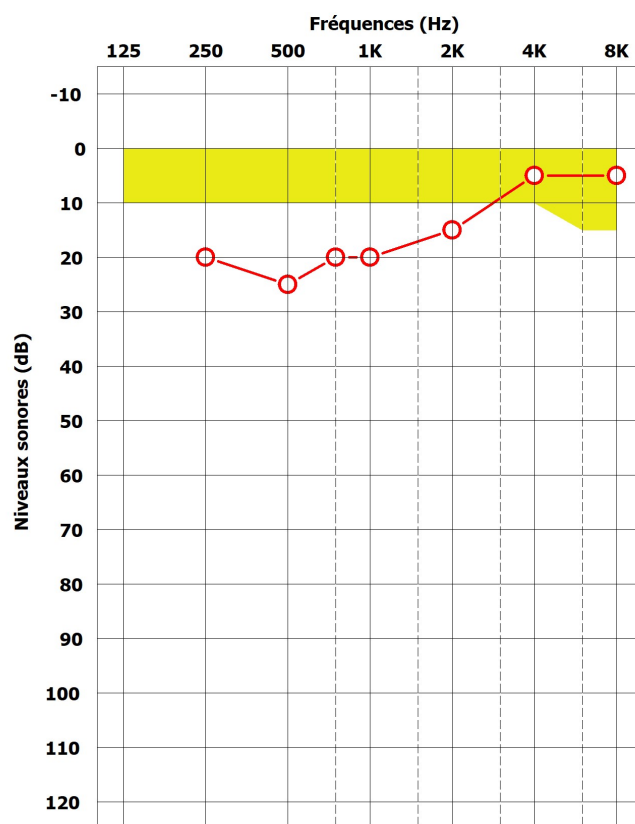

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	20	15	10		10		20		5
CA Droit		20	25	20	20		15		5		5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes

Données Patient

RAKOTOMANGA
MIRASOA IUDMII I A

Date de naissance

06/02/1986

Age

38

Société

HDS

ID

24061815103521351

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021