


MEDVIE


Date du test: 15/06/2024 14:18:31
Durée: 3mn 28s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KAMANO SAA DOBIRO	
Date de naissance	01/01/1981
Age	43
Société	GPC
ID	24061514155717615

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

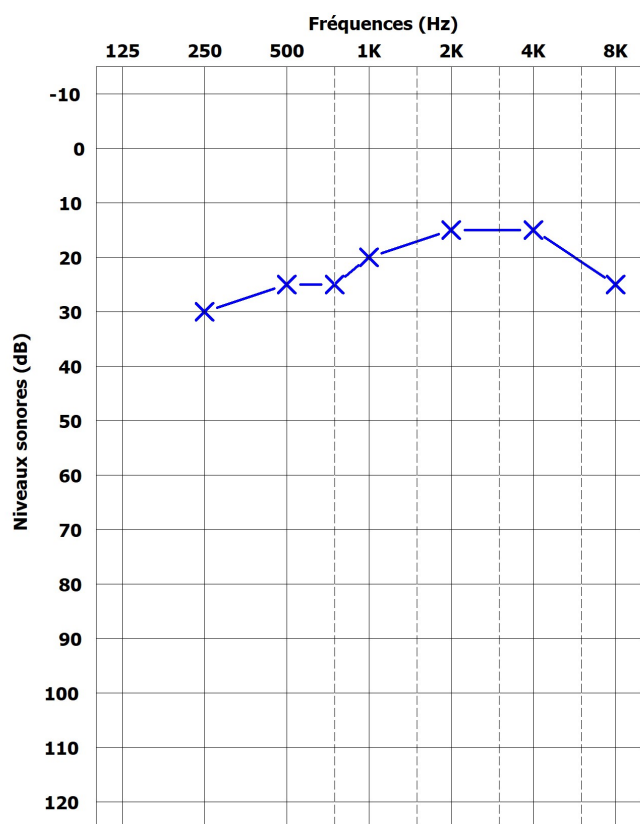

Oreille Gauche

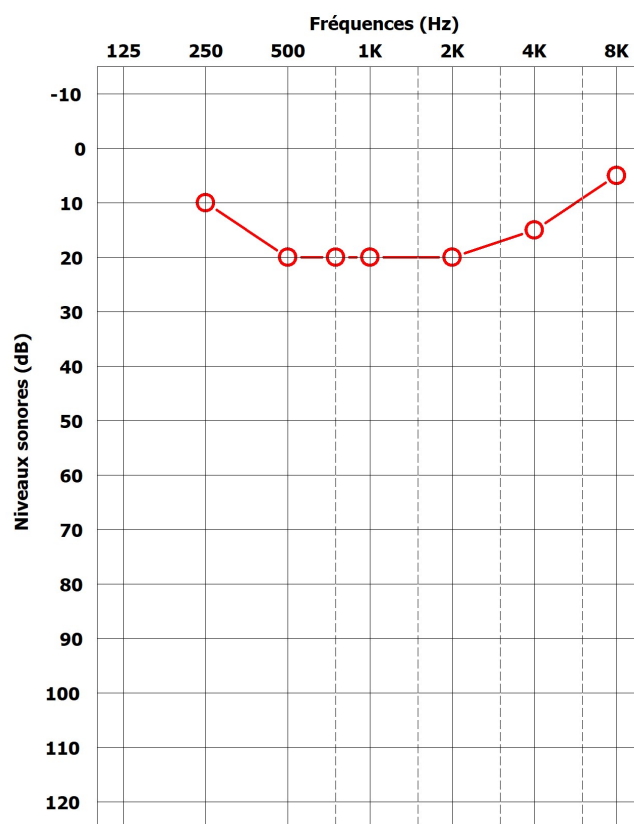

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	25	20		15		15		25
CA Droit		10	20	20	20		20		15		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes