

MEDVIE


Date du test: 15/06/2024 16:07:01

Durée: 9mn 35s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		KEITA NFALY
Date de naissance	04/04/1994	
Age	30	
Société	GPC	
ID	24061516043345945	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

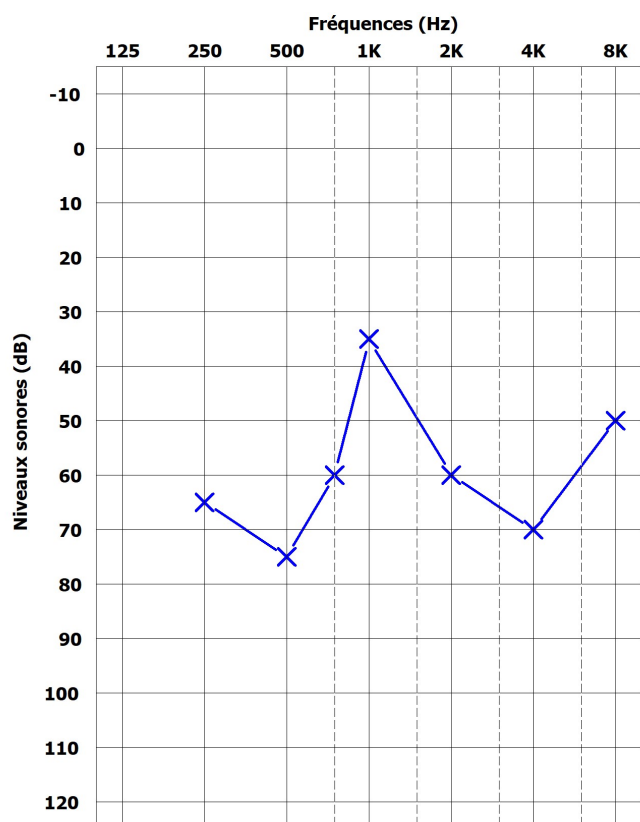

Oreille Gauche

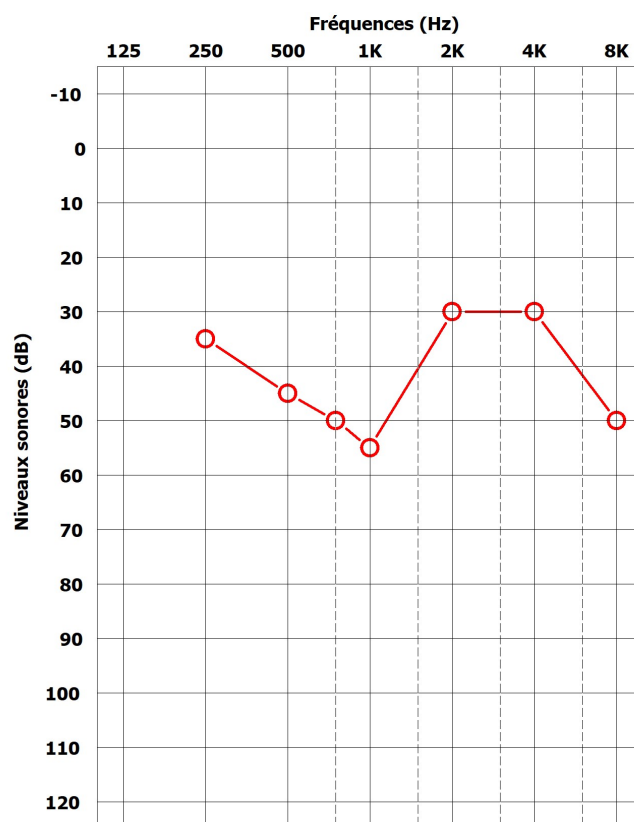

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		65	75	60	35		60		70		50
CA Droit		35	45	50	55		30		30		50

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	60,0 dB	---
CA Droit	40,0 dB	---

Notes