


MEDVIE


Date du test: 09/09/2025 10:34:05

Durée: 6mn 28s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

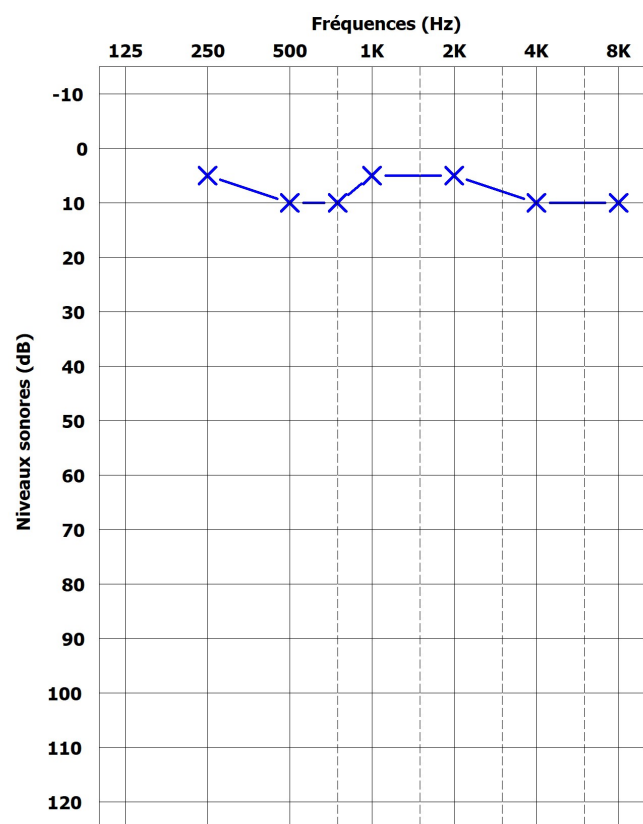

Oreille Gauche

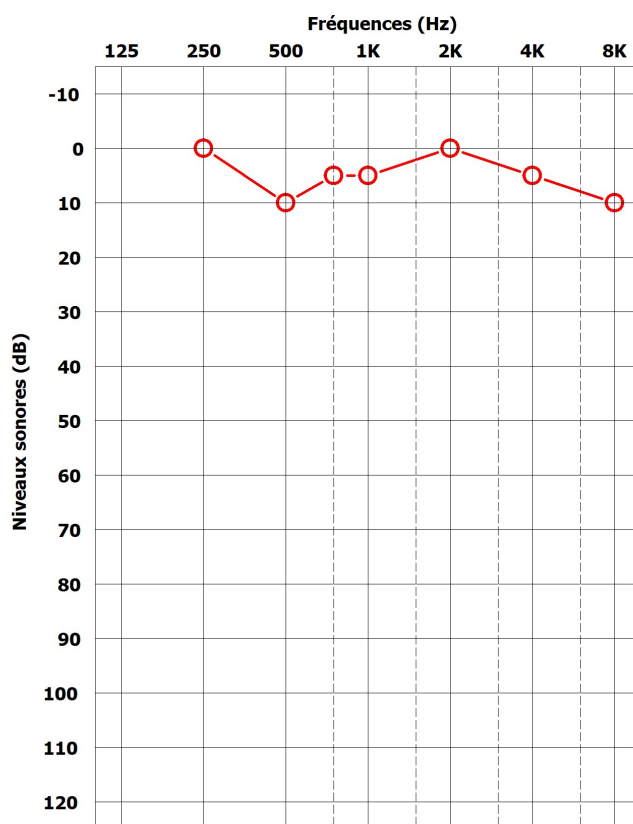

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	10	10	5		5		10		10
CA Droit		0	10	5	5		0		5		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes

Données Patient

FUFANA FAGINE I
ISSIAGA

Date de naissance

11/03/1997

Age

28

Société

GPC

ID

25090910304583886

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021