

Données Patient	
GANASEN PRAGASEN	
Date de naissance	20/08/1974
Age	50
Société	
ID	24091111000114919

MEDVIE


Date du test: 11/09/2024 11:11:02

Durée: 4mn 15s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre

Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

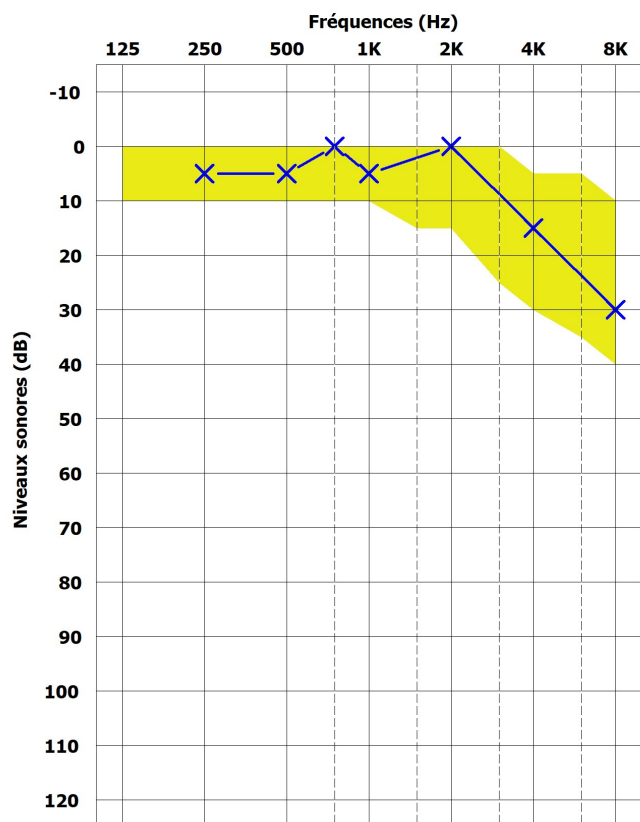

Oreille Gauche

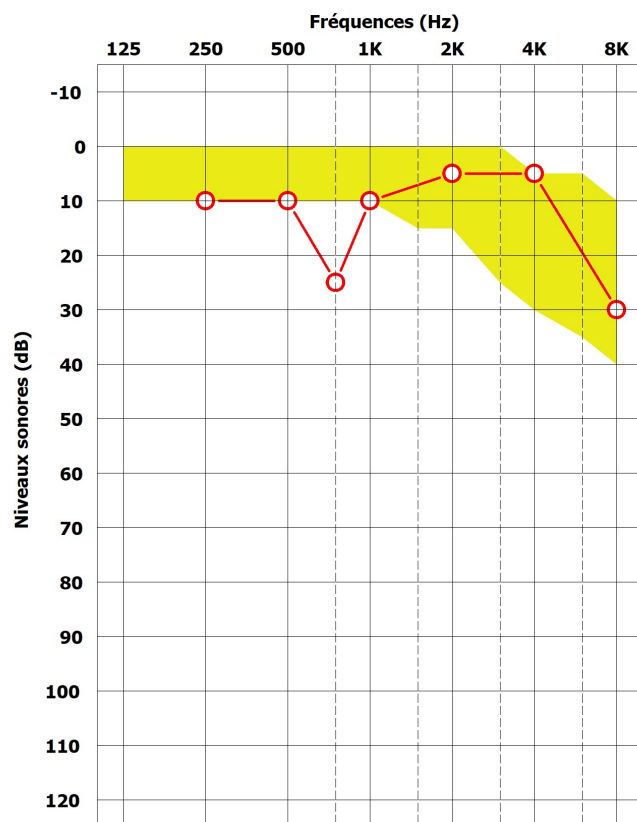

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	5	0	5		0		15		30
CA Droit		10	10	25	10		5		5		30

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes