


MEDVIE


Date du test: 18/03/2025 11:20:43

Durée: 6mn 05s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

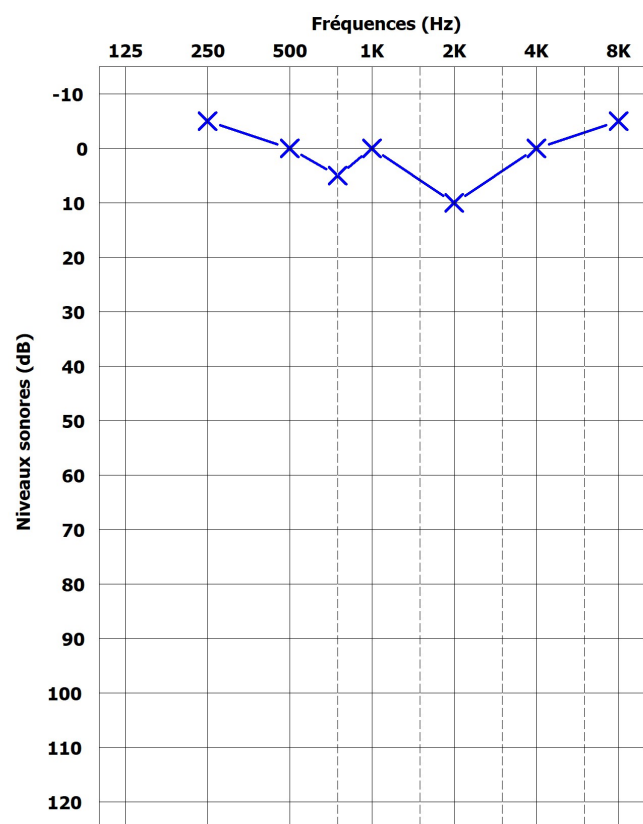

Oreille Gauche

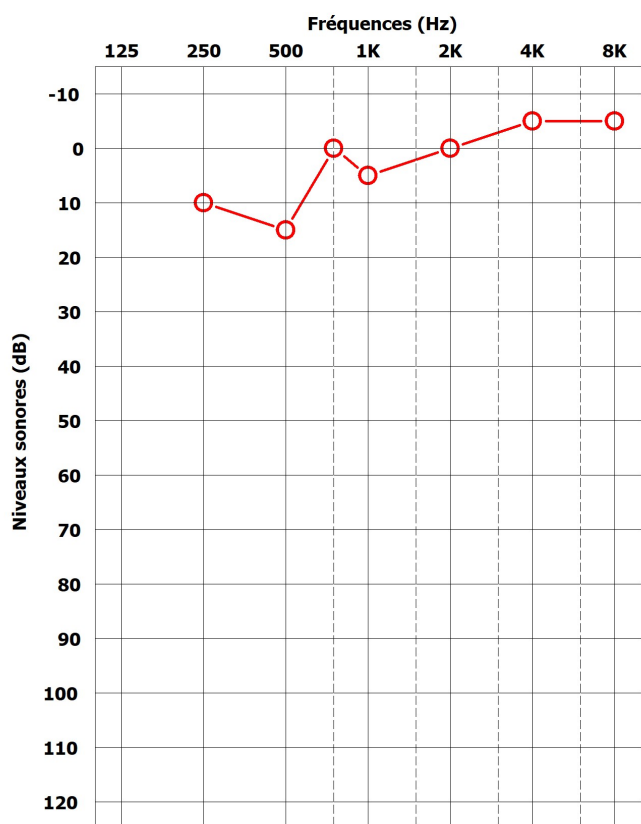

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	0	5	0		10		0		-5
CA Droit		10	15	0	5		0		-5		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	2,5 dB	---
CA Droit	3,8 dB	---

Notes

Données Patient	ZHANG SONGBAI
Date de naissance	01/09/1997
Age	27
Société	GPC
ID	25031811170246063

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021