


MEDVIE


Date du test: 26/02/2025 10:52:00
Durée: 5mn 13s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		KEITA MODIBO
Date de naissance	01/07/1980	
Age	44	
Société	GPC	
ID	25022610462279930	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

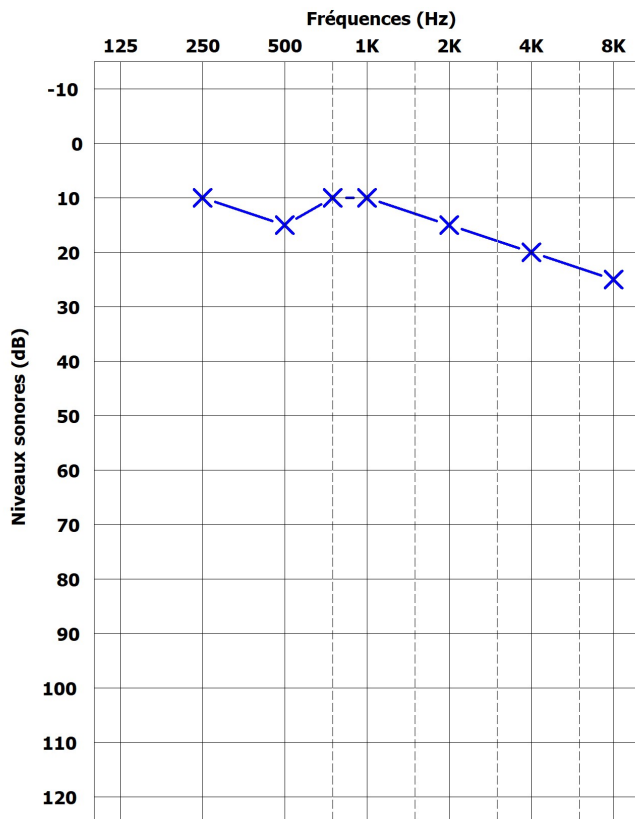

Oreille Gauche

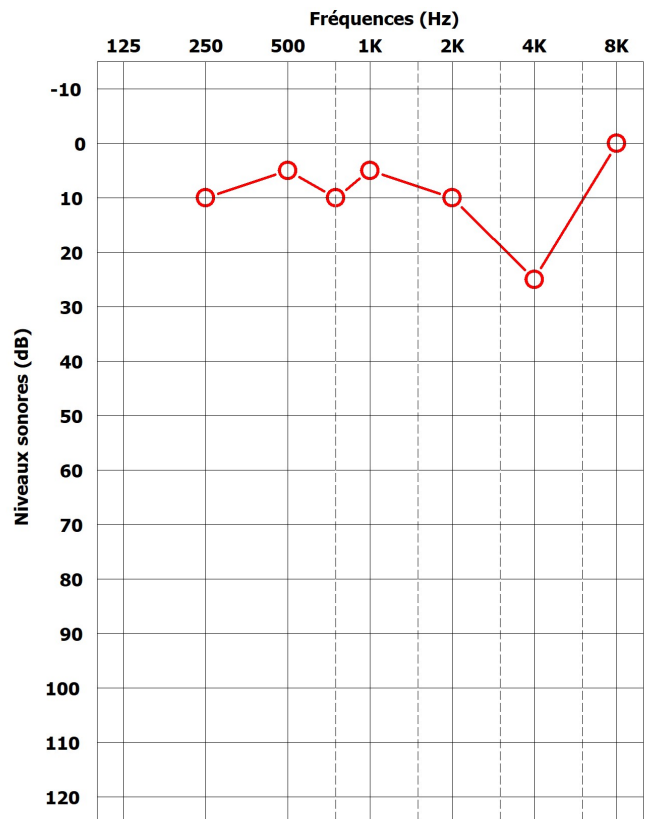

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15	10	10		15		20		25
CA Droit		10	5	10	5		10		25		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes