


MED VIE


Date du test: 22/06/2024 11:21:13  
Durée: 4mn 10s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   |                   | DIAKITE NOUHAN |
|-------------------|-------------------|----------------|
| Date de naissance | 01/01/1986        |                |
| Age               | 38                |                |
| Société           | GPC               |                |
| ID                | 24062211173492146 |                |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

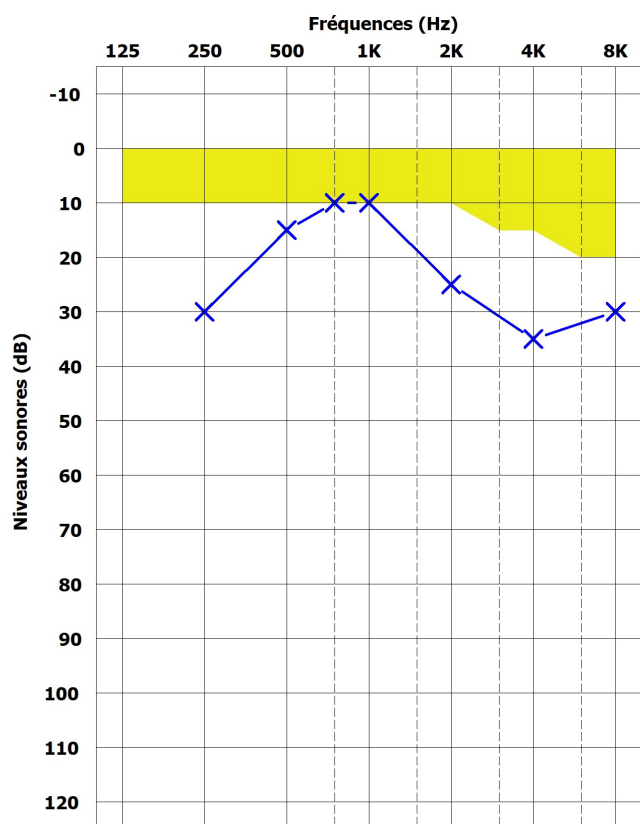

Oreille Gauche

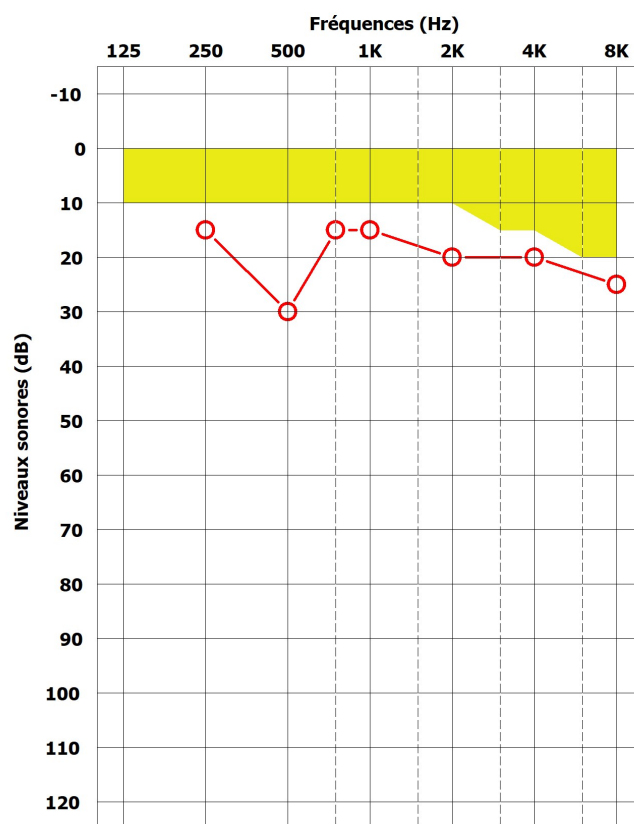

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 30  | 15  | 10  | 10 |     | 25 |    | 35 |    | 30 |
| CA Droit  |     | 15  | 30  | 15  | 15 |     | 20 |    | 20 |    | 25 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 21,3 dB | --- |
| CA Droit        | 21,3 dB | --- |

Notes