


MEDVIE


Date du test: 19/09/2024 14:49:43
Durée: 3mn 33s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
TRAORE BOUBACAR	
Date de naissance	16/12/1973
Age	50
Société	GPC
ID	24091914402237597

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

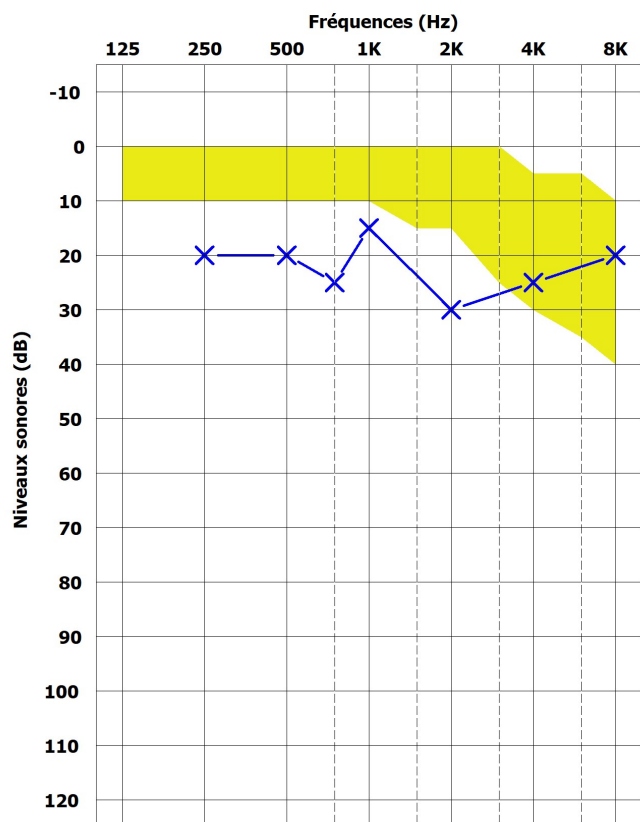

Oreille Gauche

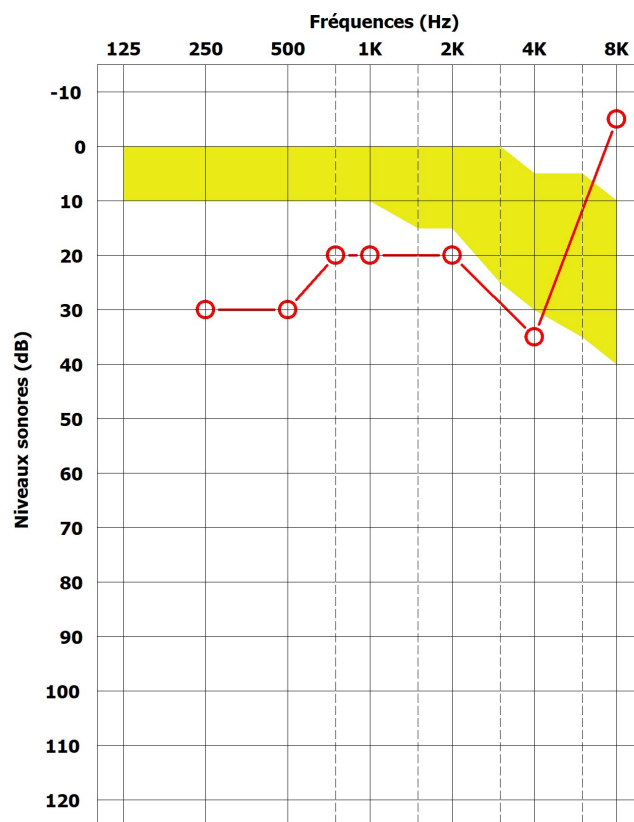

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	20	25	15		30		25		20
CA Droit		30	30	20	20		20		35		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	26,3 dB	---

Notes