


MEDVIE


Date du test: 22/07/2024 11:56:19
Durée: 6mn 43s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
MANIMOU Nyankoye	
Date de naissance	07/09/1979
Age	44
Société	GPC
ID	24072211543296709

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

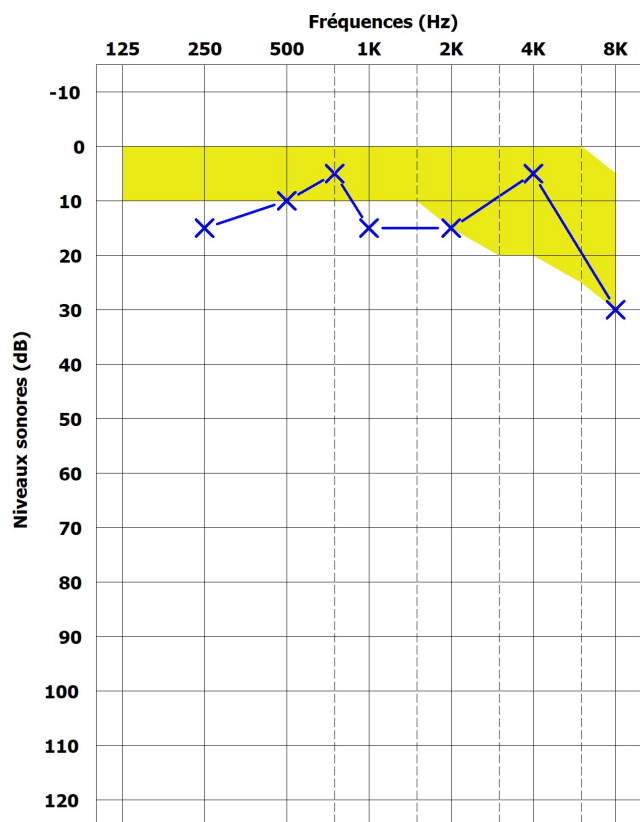

Oreille Gauche

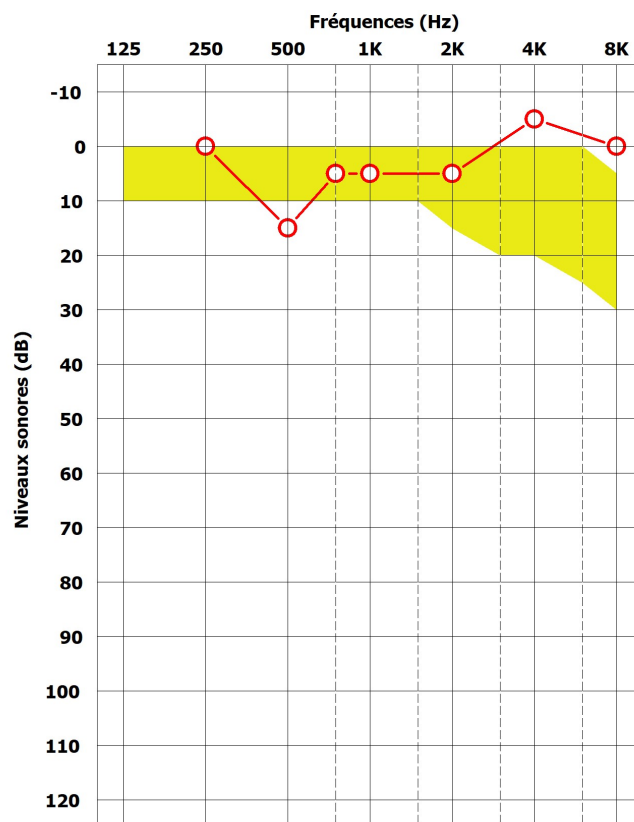

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	10	5	15		15		5		30
CA Droit		0	15	5	5		5		-5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes