

MEDVIE


Date du test: 18/04/2024 14:58:56

Durée: 7mn 47s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   | KEÏTA FREBORY     |
|-------------------|-------------------|
| Date de naissance | 01/04/1984        |
| Age               | 40                |
| Société           | GPC               |
| ID                | 24041814530623051 |

| Audiomètre                     |
|--------------------------------|
| Type: Audio 820M V2,211        |
| Numéro de série: 2111EAT690093 |
| Date Calibration : 30/11/2021  |

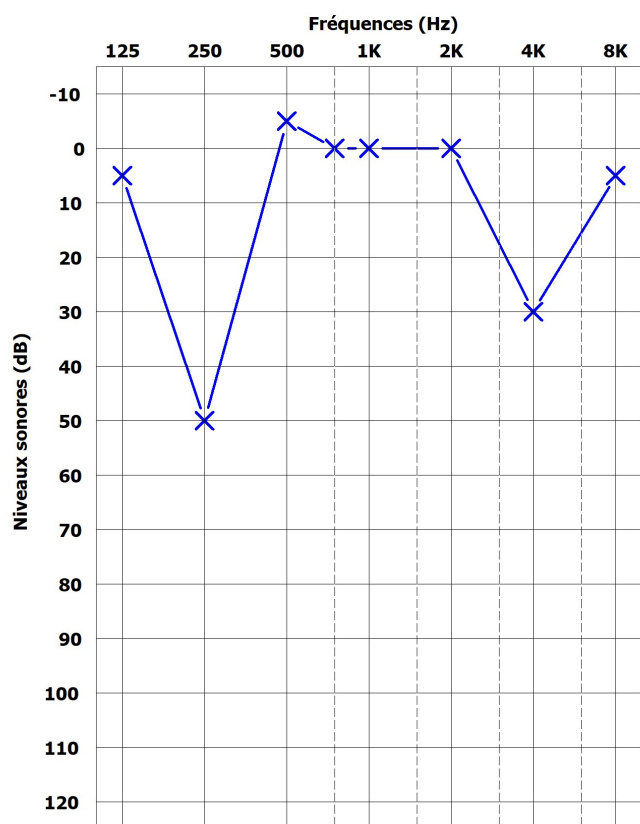

Oreille Gauche

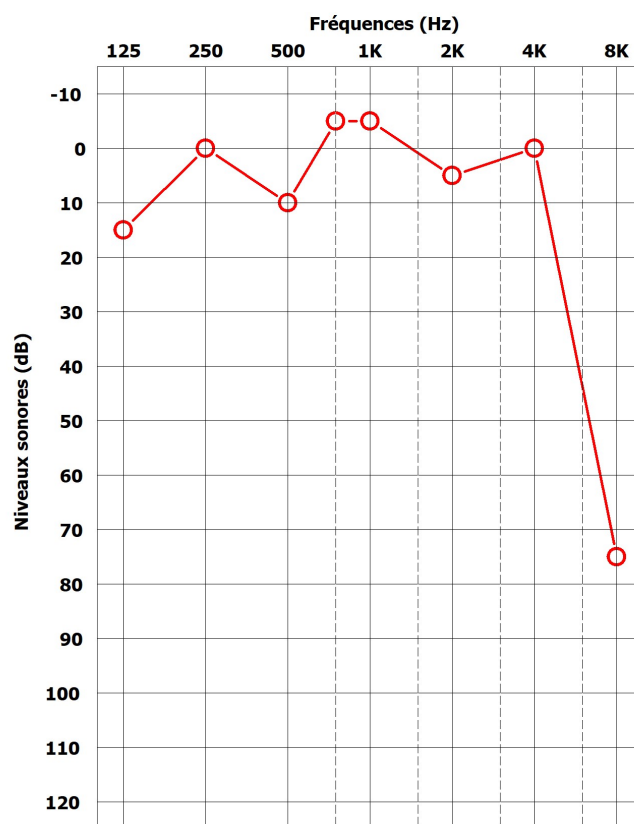

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche | 5   | 50  | -5  | 0   | 0  |     | 0  |    | 30 |    | 5  |
| CA Droit  | 15  | 0   | 10  | -5  | -5 |     | 5  |    | 0  |    | 75 |

| Calcul de perte | PAM    | IPA |
|-----------------|--------|-----|
| CA Gauche       | 6,3 dB | --- |
| CA Droit        | 2,5 dB | --- |

Notes