

MEDVIE


Date du test: 04/03/2024 11:06:10

Durée: 6mn 09s


Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		KEÏTA FODE
Date de naissance	14/02/1989	
Age	35	
Société	GPC	
ID	24030410572110418	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

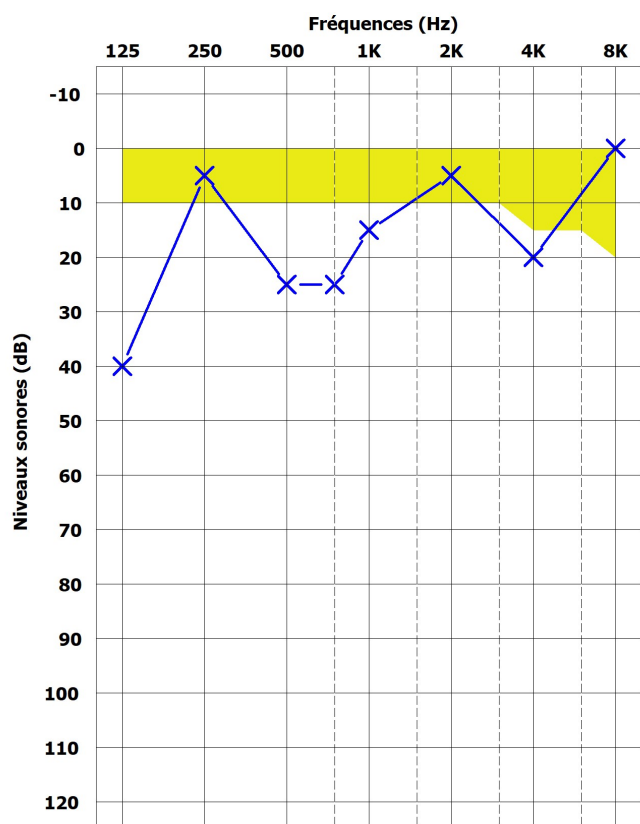

Oreille Gauche

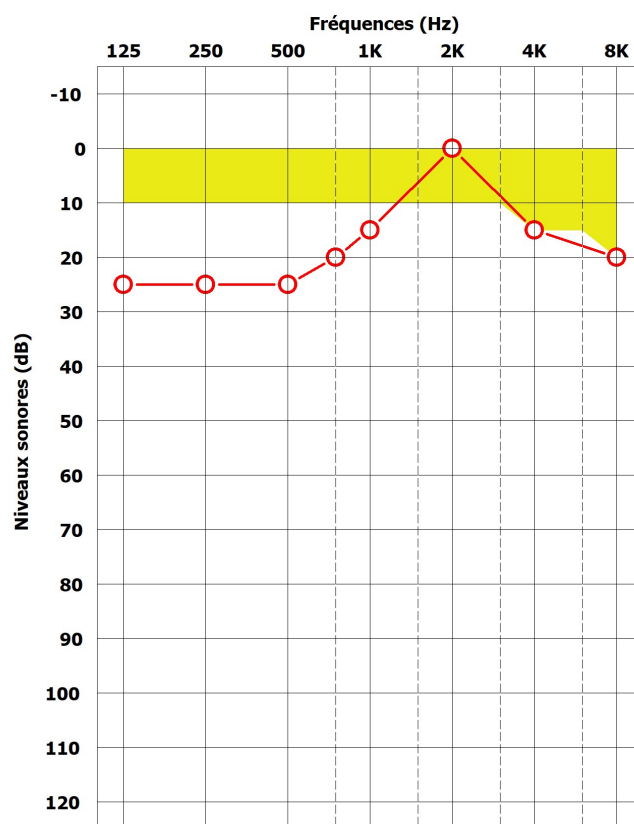

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	40	5	25	25	15		5		20		0
CA Droit	25	25	25	20	15		0		15		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes