


MED VIE


Date du test: 18/06/2024 10:34:14
Durée: 3mn 47s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BANGOURA YOUSSEUF	
Date de naissance	01/01/1984
Age	40
Société	GPC
ID	24061810301464515

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

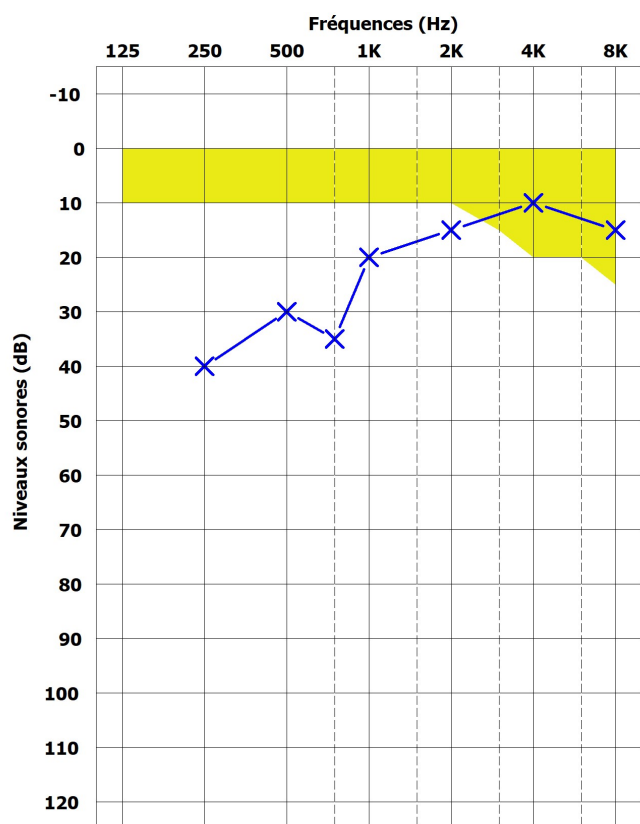

Oreille Gauche

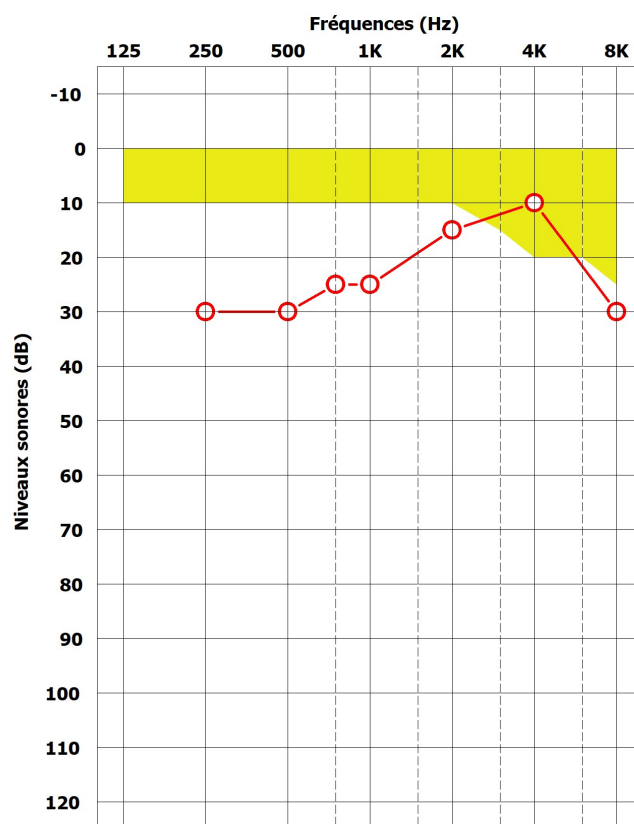

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		40	30	35	20		15		10		15
CA Droit		30	30	25	25		15		10		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes