



Données Patient


**FOFANA ANSOUMANE**

Date de naissance 01/01/2000  
Age 25  
Société GPC  
ID 25011511325178680


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211  
Numéro de série: 2111EAT690093  
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 15/01/2025 11:46:31  
Durée: 4mn 08s  
Type test Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

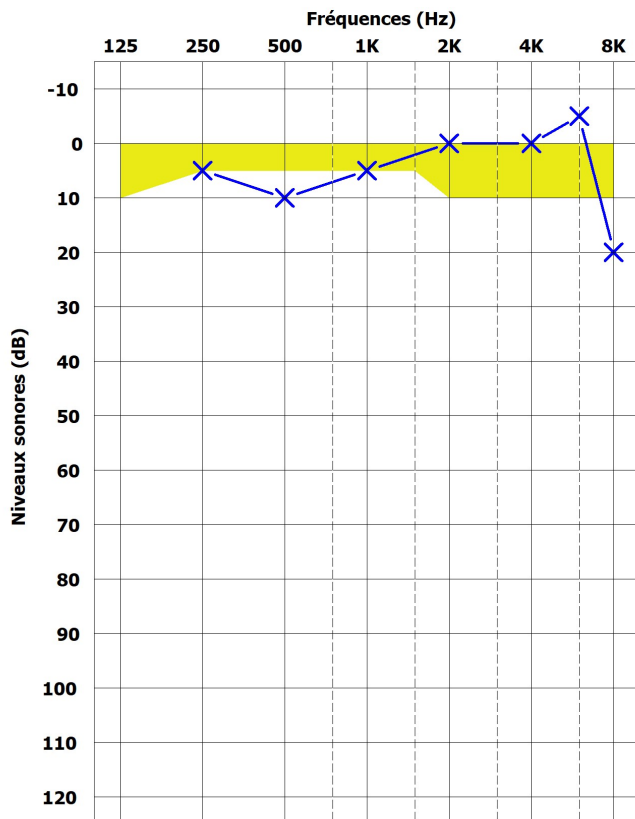

Oreille Gauche

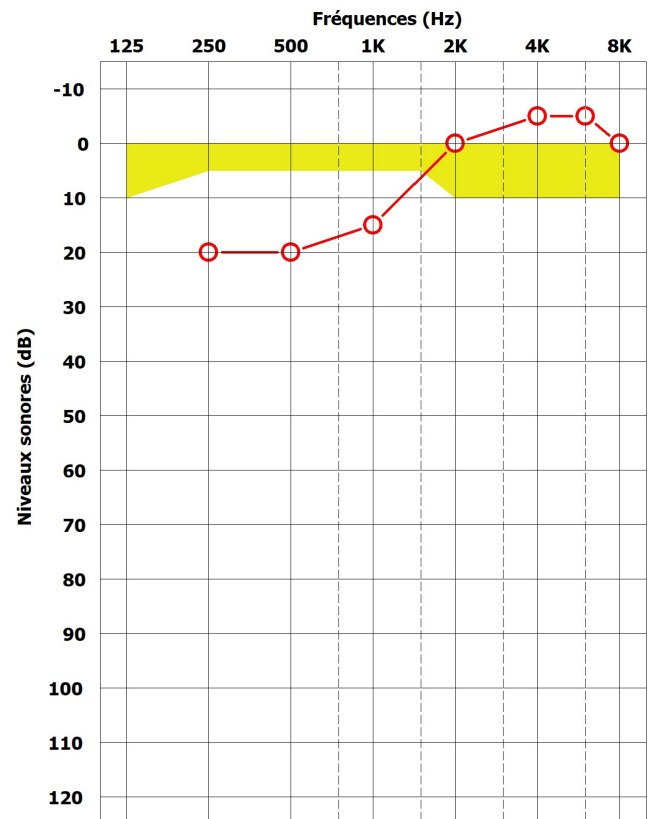

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 5   | 10  |     | 5  |     | 0  |    | 0  | -5 | 20 |
| CA Droit  |     | 20  | 20  |     | 15 |     | 0  |    | -5 | -5 | 0  |

Calcul de perte

|           | PAM |         |
|-----------|-----|---------|
| CA Gauche | --- | 5,0 dB  |
| CA Droit  | --- | 15,0 dB |

Notes