



| Données Patient       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>SOUMAORO SEKOU</b> |                   |
| Date de naissance     | 01/01/1978        |
| Age                   | 47                |
| Société               | GPC               |
| ID                    | 25011510591699568 |

Date du test: 15/01/2025 11:00:54  
Durée: 4mn 02s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

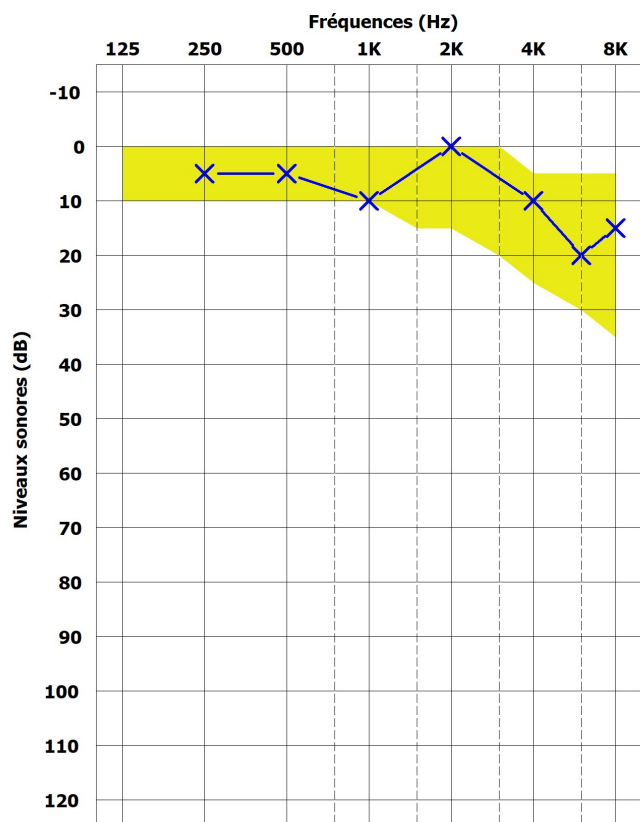

Oreille Gauche

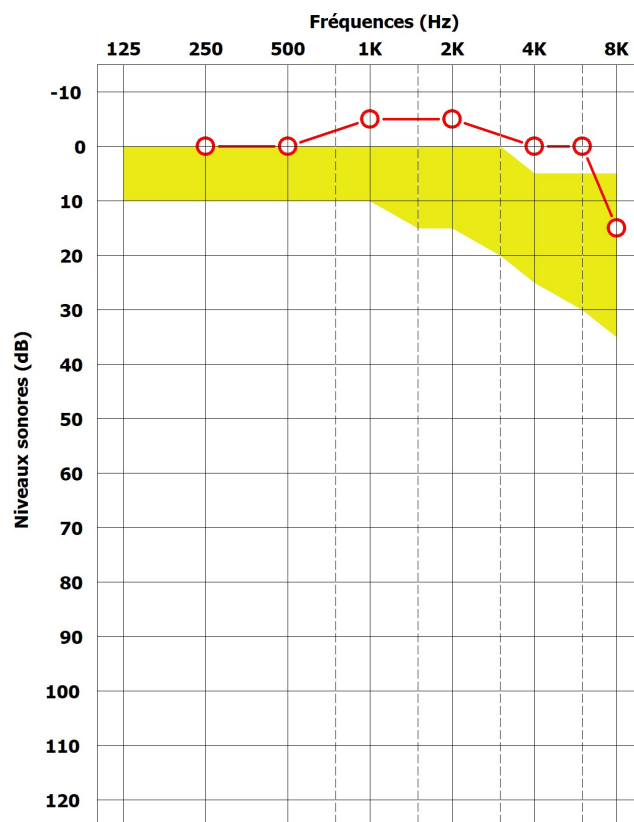

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 5   | 5   |     | 10 |     | 0  |    | 10 | 20 | 15 |
| CA Droit  |     | 0   | 0   |     | -5 |     | -5 |    | 0  | 0  | 15 |

| Calcul de perte | PAM |         |
|-----------------|-----|---------|
| CA Gauche       | --- | 10,0 dB |
| CA Droit        | --- | -5,0 dB |

Notes