


MEDVIE


Date du test: 08/04/2025 10:43:15
Durée: 4mn 44s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BALDE BOUBACAR	
Date de naissance	01/01/1992
Age	33
Société	GPC
ID	25040810410610349

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

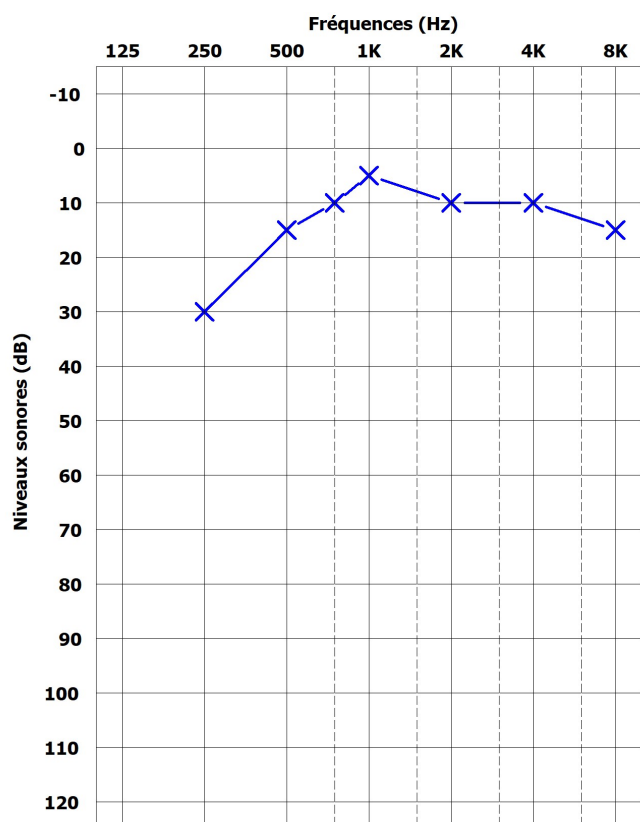

Oreille Gauche

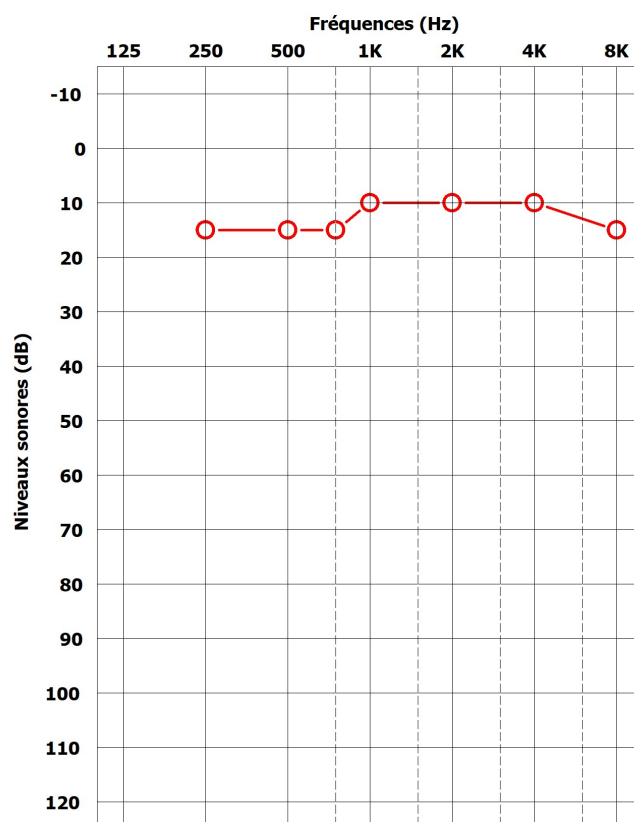

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	15	10	5		10		10		15
CA Droit		15	15	15	10		10		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes