

MEDVIE


Date du test: 23/04/2024 10:17:27

Durée: 6mn 31s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   | CAMARA MOHAMED    |
|-------------------|-------------------|
| Date de naissance | 07/07/1996        |
| Age               | 27                |
| Société           | GPC               |
| ID                | 24042310092586880 |

| Audiomètre                     |
|--------------------------------|
| Type: Audio 820M V2,211        |
| Numéro de série: 2111EAT690093 |
| Date Calibration : 30/11/2021  |

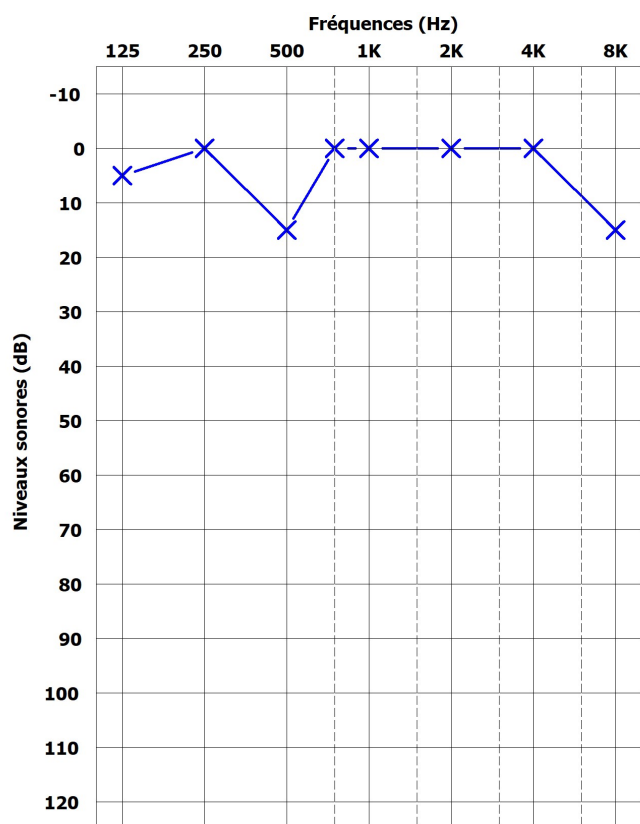

Oreille Gauche

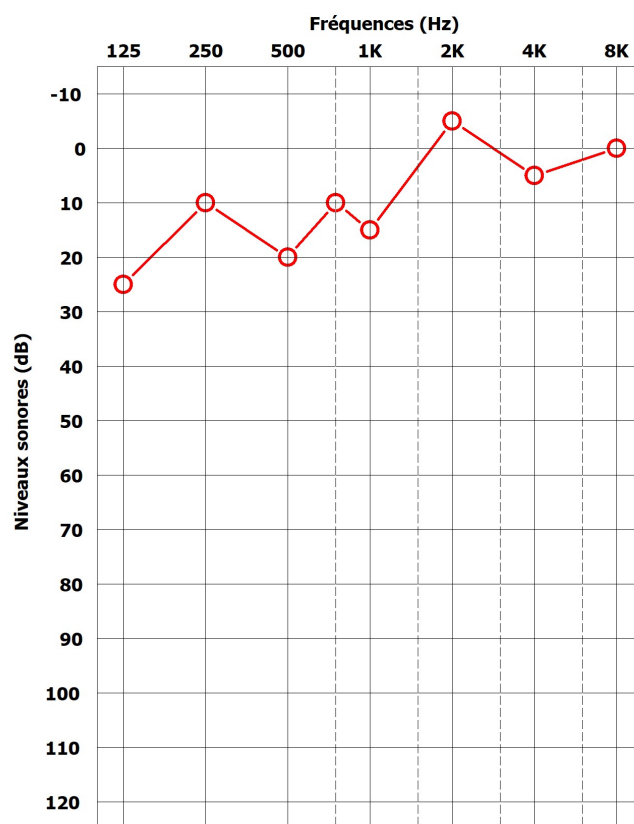

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche | 5   | 0   | 15  | 0   | 0  |     | 0  |    | 0  |    | 15 |
| CA Droit  | 25  | 10  | 20  | 10  | 15 |     | -5 |    | 5  |    | 0  |

| Calcul de perte | PAM    | IPA |
|-----------------|--------|-----|
| CA Gauche       | 3,8 dB | --- |
| CA Droit        | 8,8 dB | --- |

Notes