

MEDVIE


Date du test: 28/04/2025 11:52:42

Durée: 5mn 19s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CAMARA OUMAR
Date de naissance	12/06/1994	
Age	30	
Société	GPC	
ID	25042811505222189	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

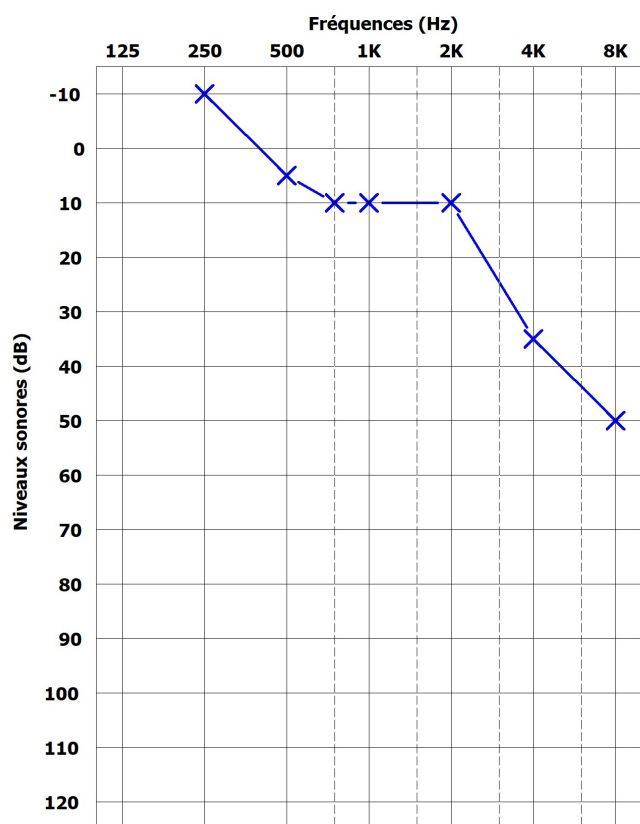

Oreille Gauche

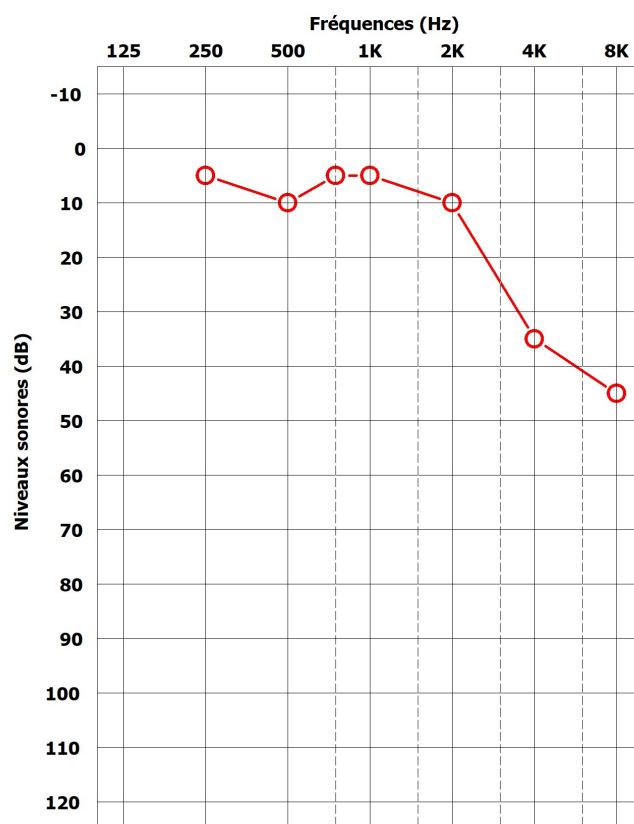

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	5	10	10		10		35		50
CA Droit		5	10	5	5		10		35		45

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes