


MEDVIE


Date du test: 23/09/2024 14:34:25  
Durée: 3mn 51s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   |                   |
|-------------------|-------------------|
| KANE MAMOUDOU     |                   |
| Date de naissance | 31/12/1983        |
| Age               | 40                |
| Société           | GPC               |
| ID                | 24092314310474656 |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690092     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

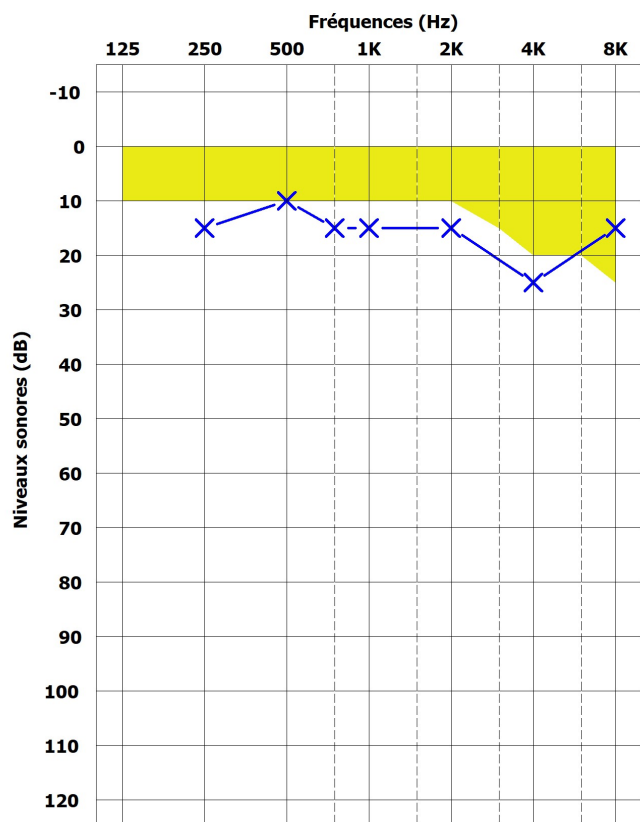

Oreille Gauche

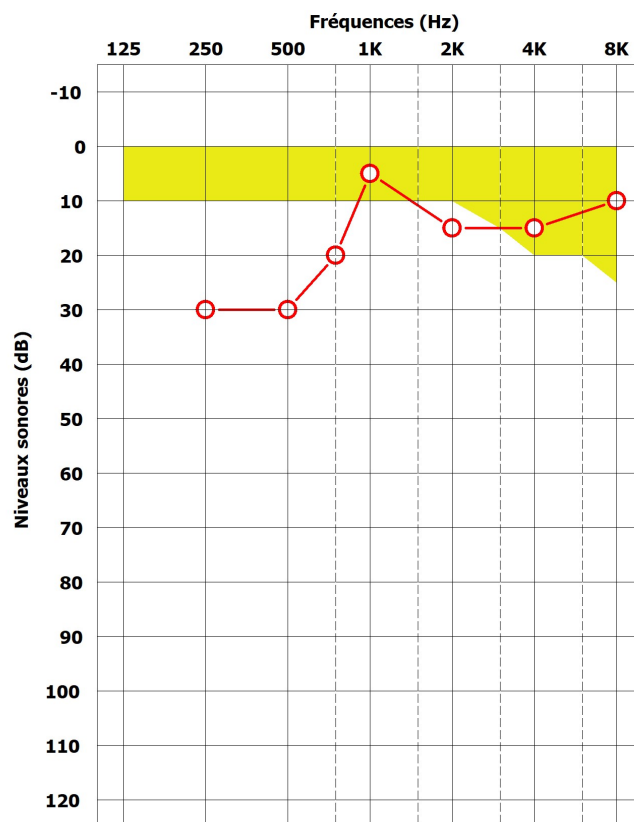

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 15  | 10  | 15  | 15 |     | 15 |    | 25 |    | 15 |
| CA Droit  |     | 30  | 30  | 20  | 5  |     | 15 |    | 15 |    | 10 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 16,3 dB | --- |
| CA Droit        | 16,3 dB | --- |

Notes