

MEDVIE


Date du test: 17/03/2025 09:07:53

Durée: 6mn 31s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	ZIETMAN IGNATIUS
Date de naissance	12/03/1987
Age	38
Société	GPC
ID	25031709041459807

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

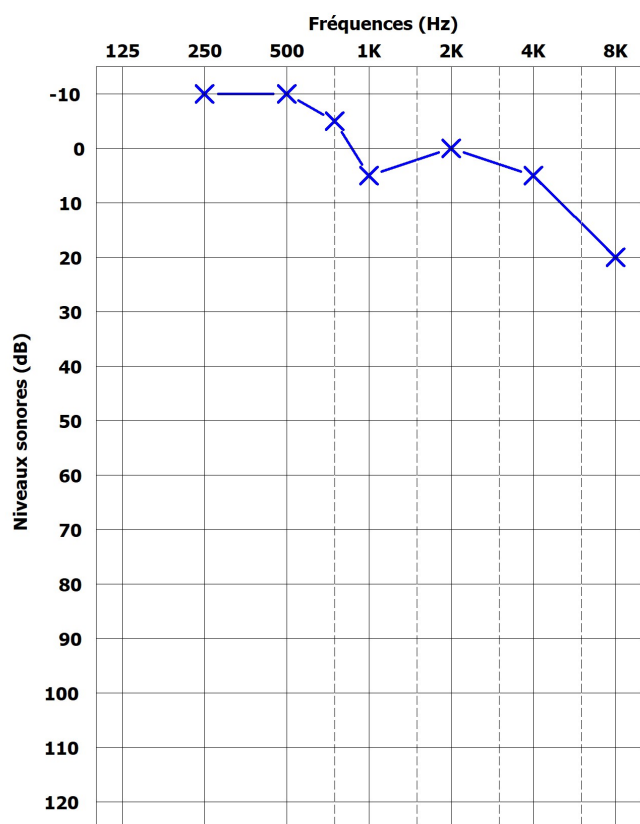

Oreille Gauche

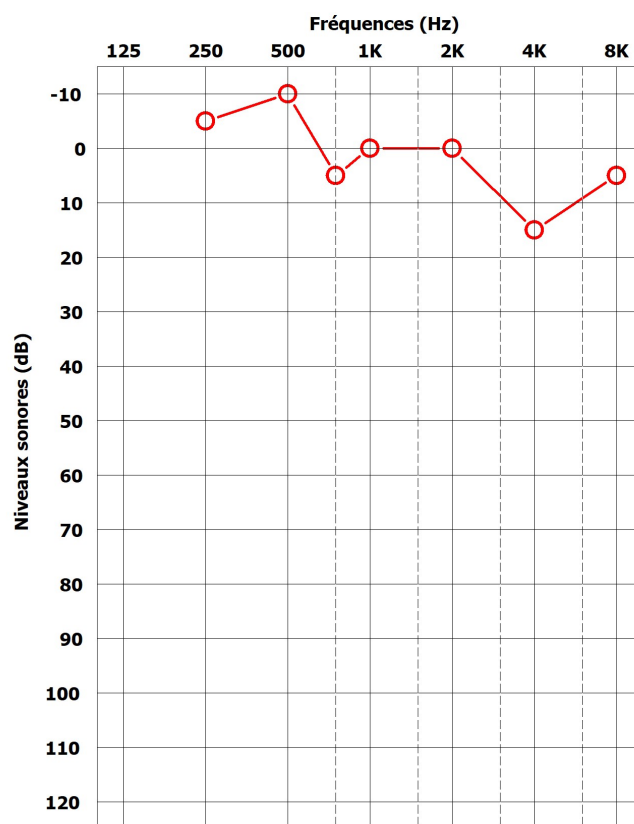

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	-10	-5	5		0		5		20
CA Droit		-5	-10	5	0		0		15		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	0,0 dB	---
CA Droit	1,3 dB	---

Notes