

MEDVIE

Date du test: 28/04/2025 09:40:40

Durée: 4mn 17s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

CAMARA SIAKA

Date de naissance 01/01/1996

Age 29

Société GPC


ID 25042809140413066

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

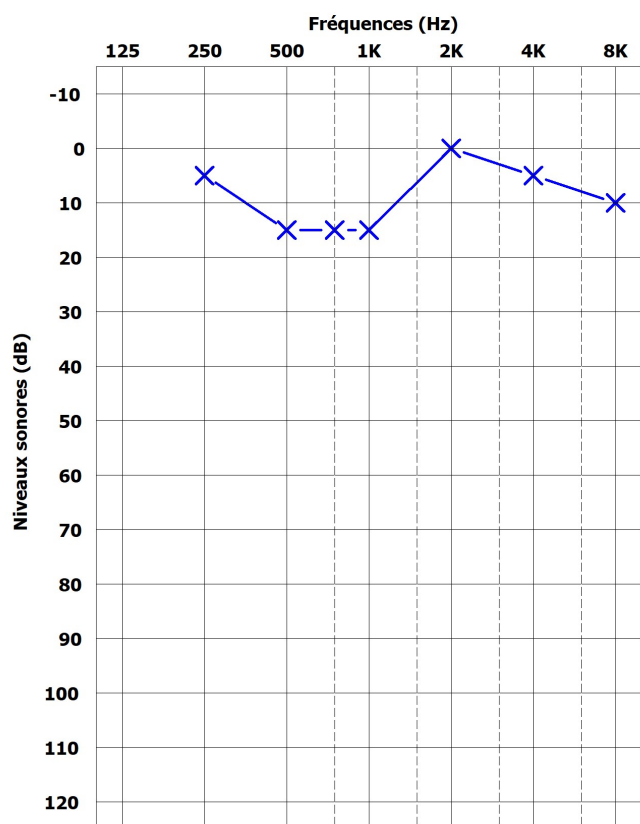

Oreille Gauche

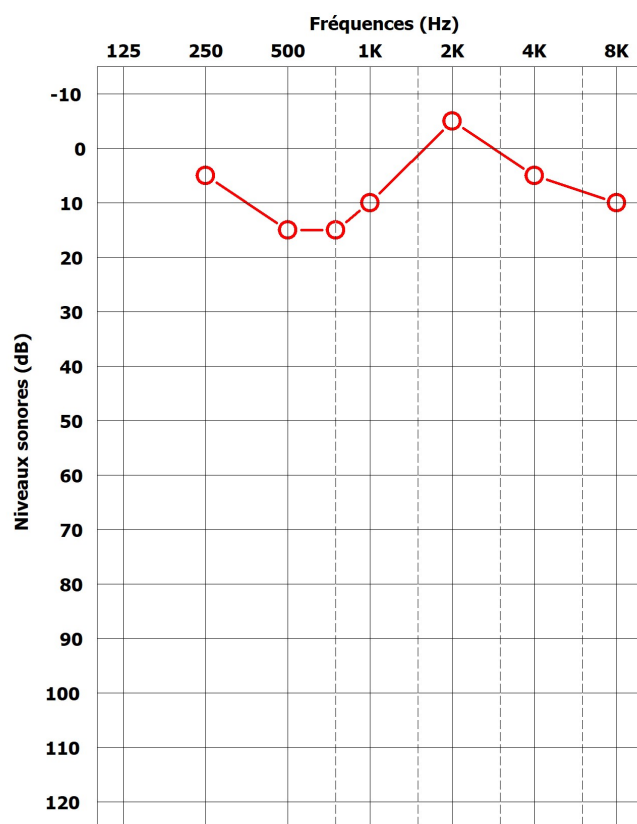

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	15	15	15		0		5		10
CA Droit		5	15	15	10		-5		5		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes