

MEDVIE


Date du test: 07/08/2024 14:36:00

Durée: 5mn 02s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	KAMANO SAA SEKOU
Date de naissance	27/12/1990
Age	33
Société	GPC
ID	24080714341739729

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

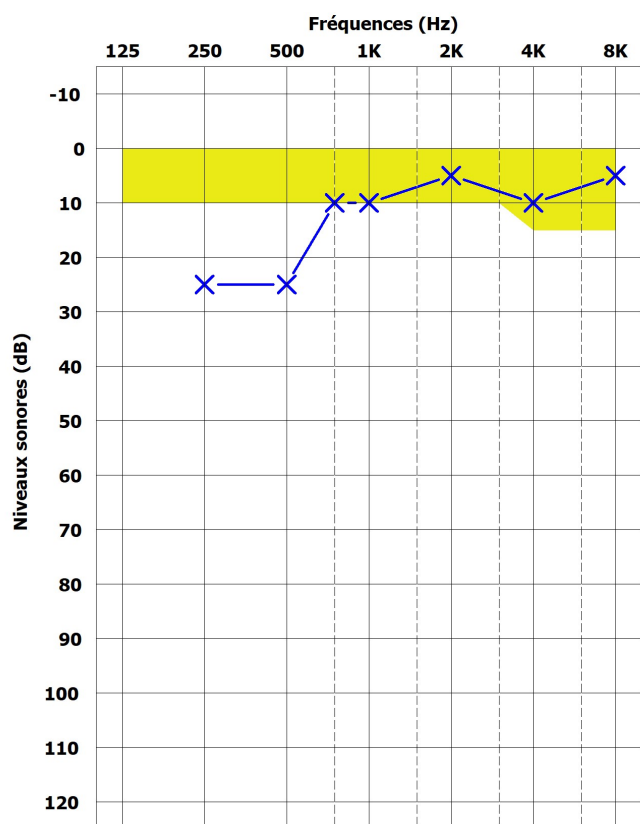

Oreille Gauche

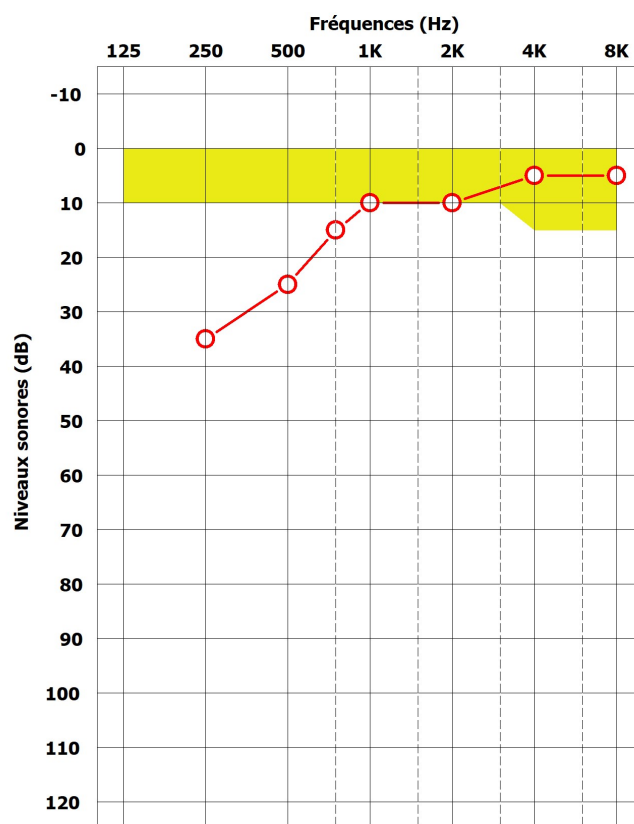

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	10	10		5		10		5
CA Droit		35	25	15	10		10		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes