

MEDVIE


Date du test: 28/04/2025 10:10:19

Durée: 4mn 13s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CAMARA FODE
Date de naissance	01/01/1981	
Age	44	
Société	GPC	
ID	25042810081999503	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

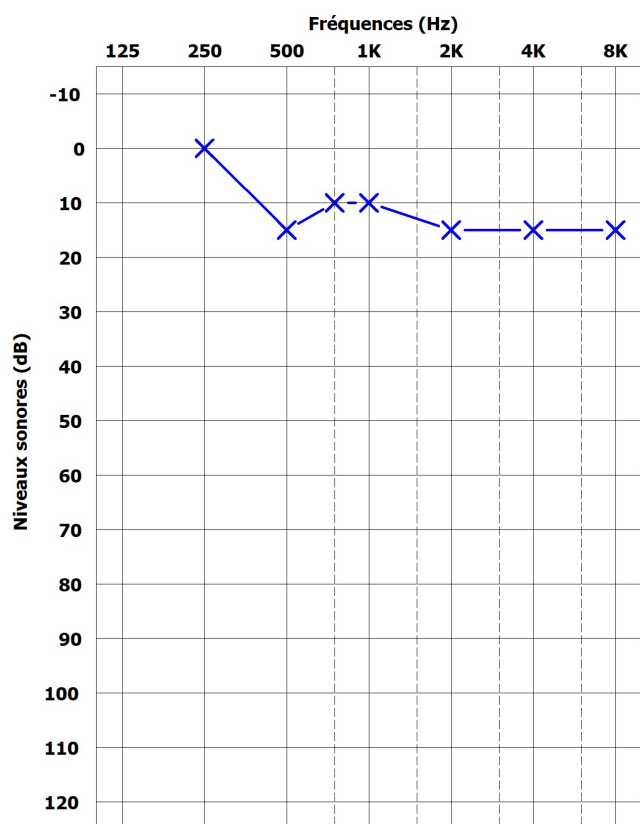

Oreille Gauche

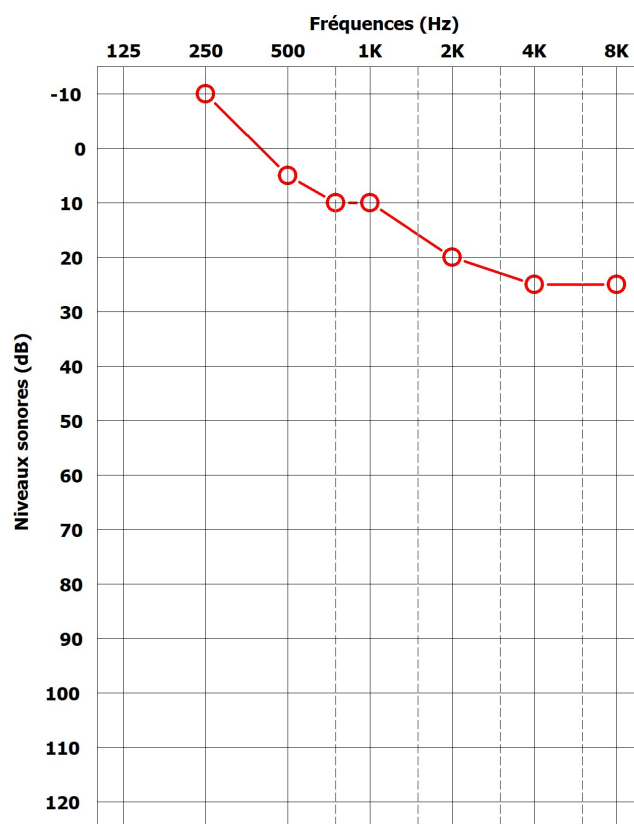

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	15	10	10		15		15		15
CA Droit		-10	5	10	10		20		25		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes