


MEDVIE


Date du test: 28/06/2025 10:45:06
Durée: 5mn 10s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SOW THIERNO OUMAR SINY	
Date de naissance	06/06/1990
Age	35
Société	GPC
ID	25062810431597470

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

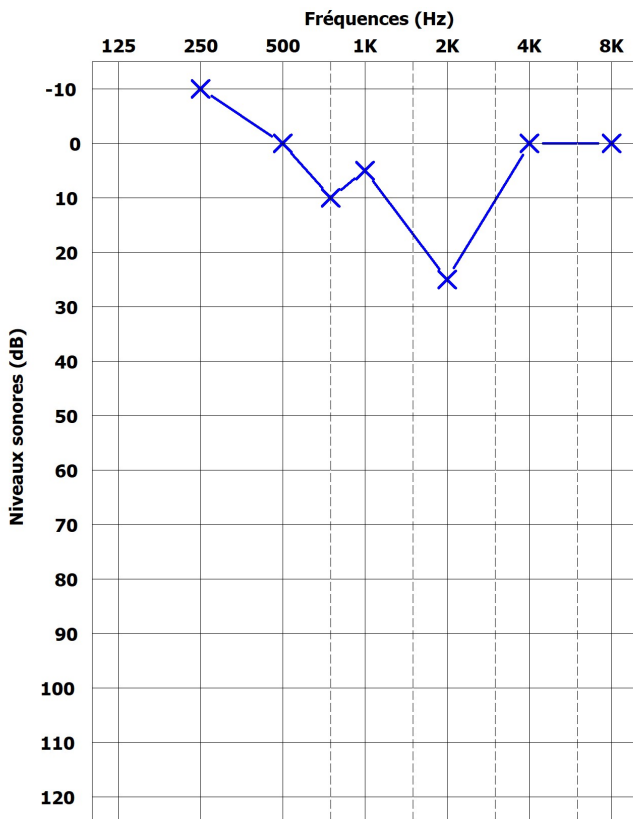

Oreille Gauche

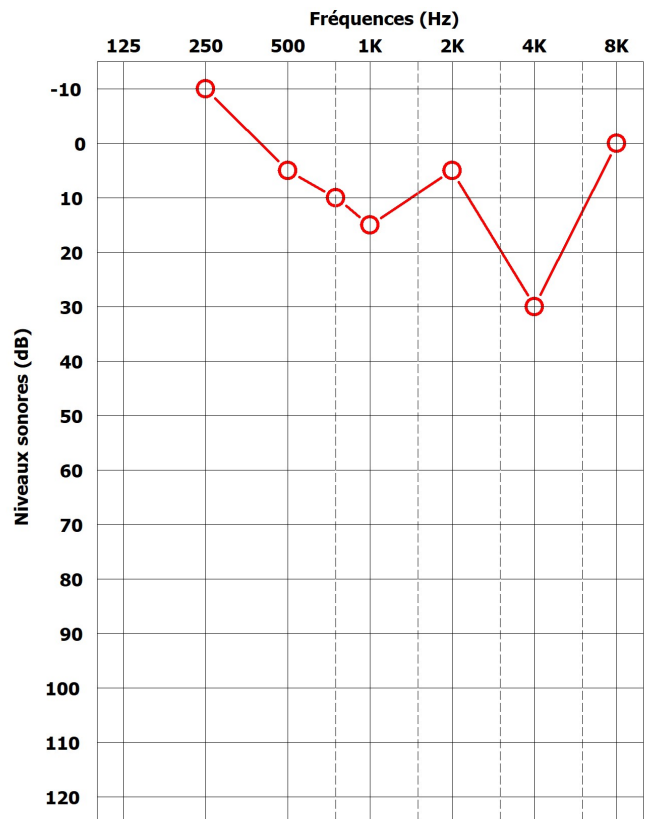

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	0	10	5		25		0		0
CA Droit		-10	5	10	15		5		30		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes