


MEDVIE


Date du test: 08/08/2024 15:53:03
Durée: 4mn 35s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIALLO OUMAR RAFIOU	
Date de naissance	20/07/1996
Age	28
Société	GPC
ID	24080815492944933

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

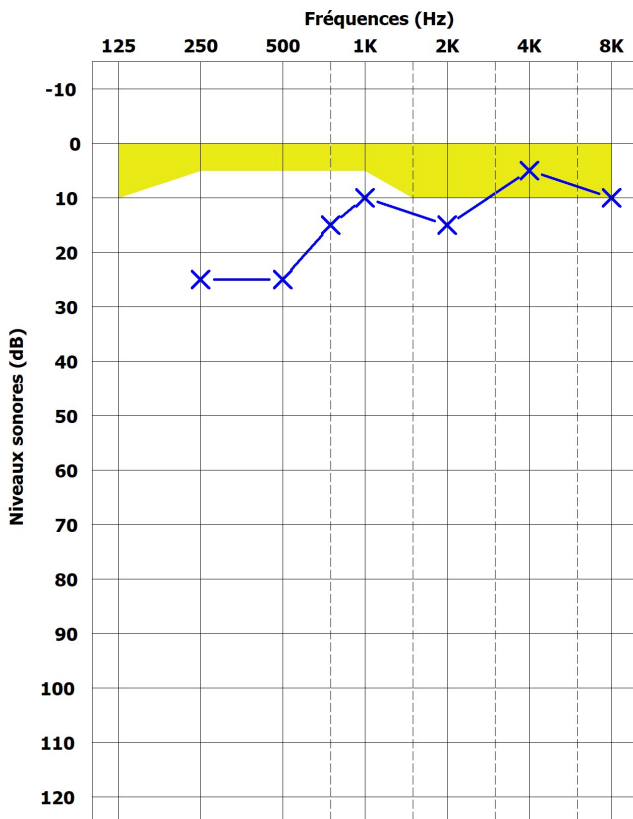

Oreille Gauche

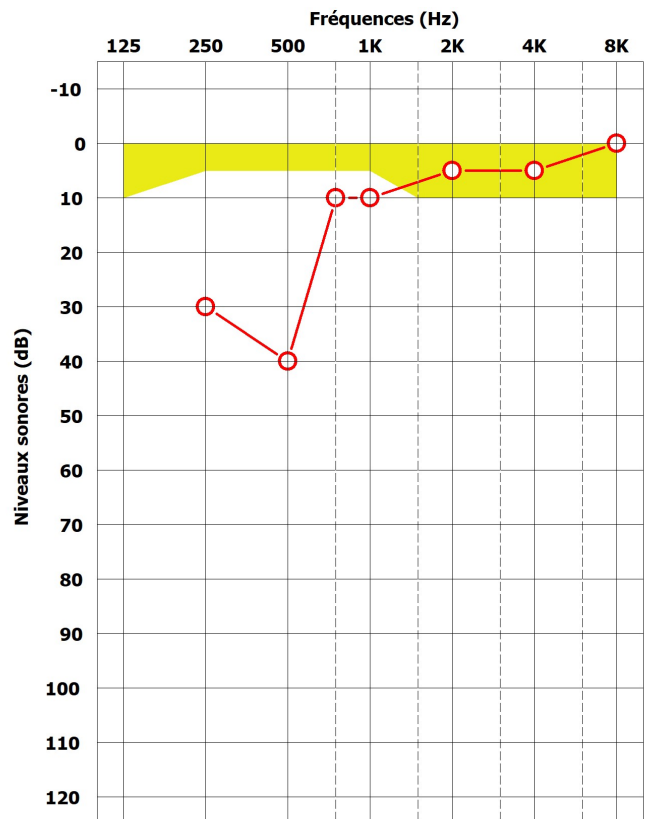

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	15	10		15		5		10
CA Droit		30	40	10	10		5		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes