


MEDVIE


Date du test: 31/01/2025 13:58:33

Durée: 3mn 37s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

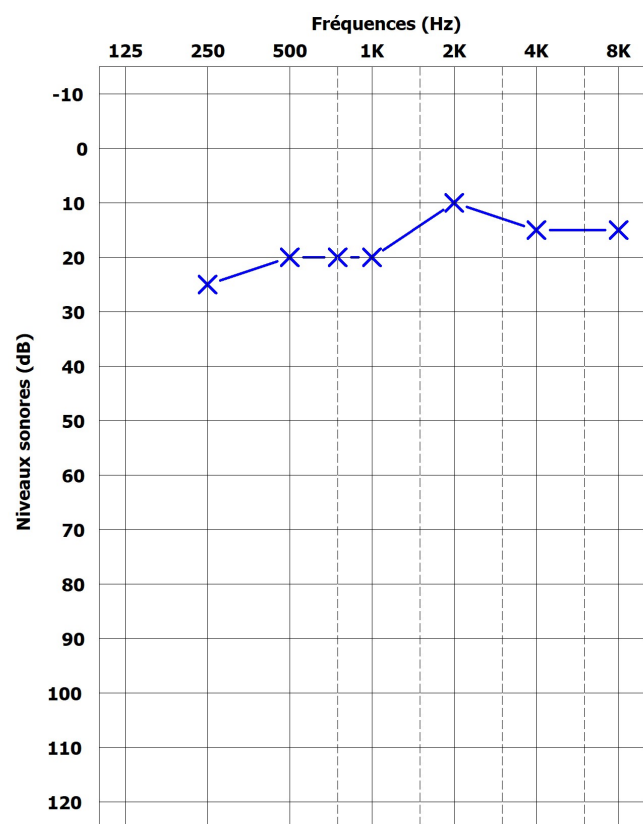

Oreille Gauche

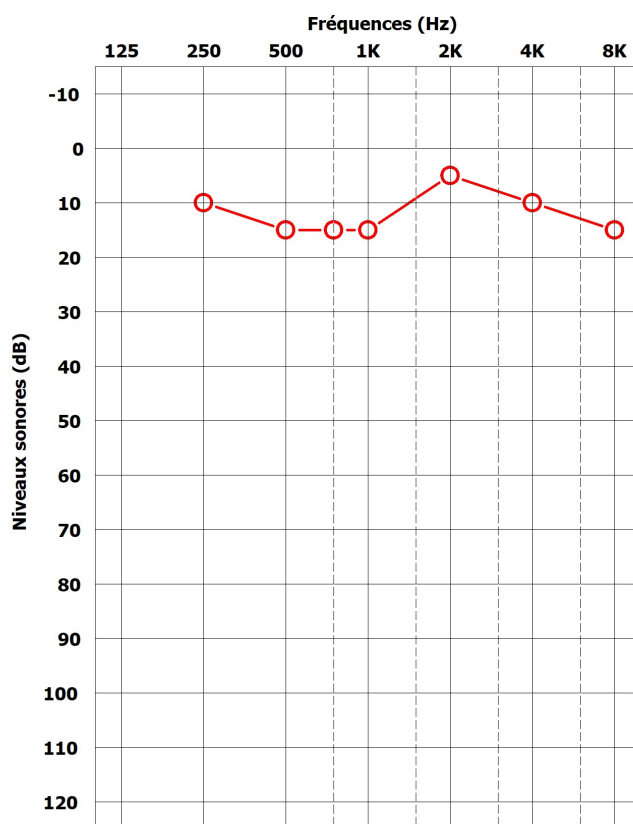

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20	20	20		10		15		15
CA Droit		10	15	15	15		5		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes

Données Patient	CAMARA Bountouraby
Date de naissance	04/06/1988
Age	36
Société	gpc
ID	25013113505038634

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021