


MEDVIE


Date du test: 07/08/2024 12:06:01
Durée: 3mn 44s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SOUMAH MUHAMED I AMINE	
Date de naissance	27/12/1992
Age	31
Société	GPC
ID	24080712045911731

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

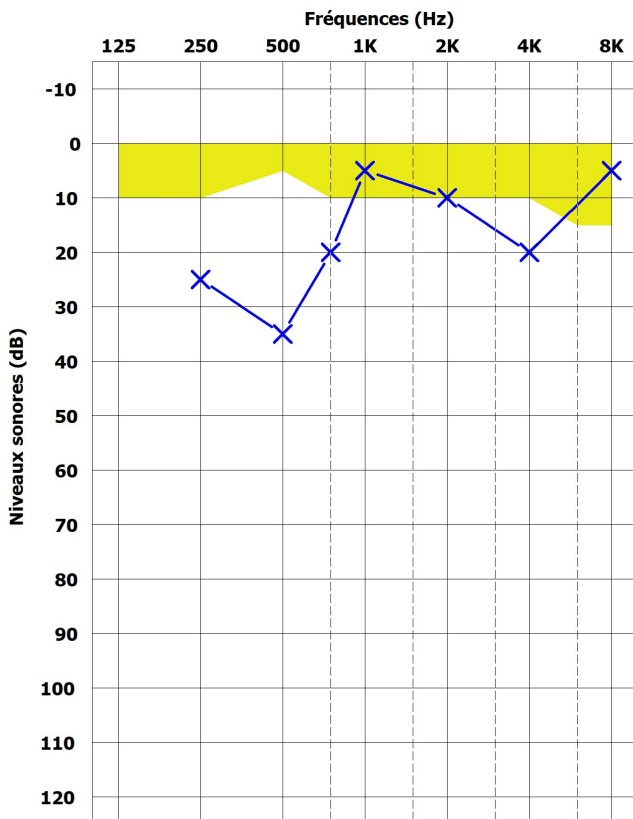

Oreille Gauche

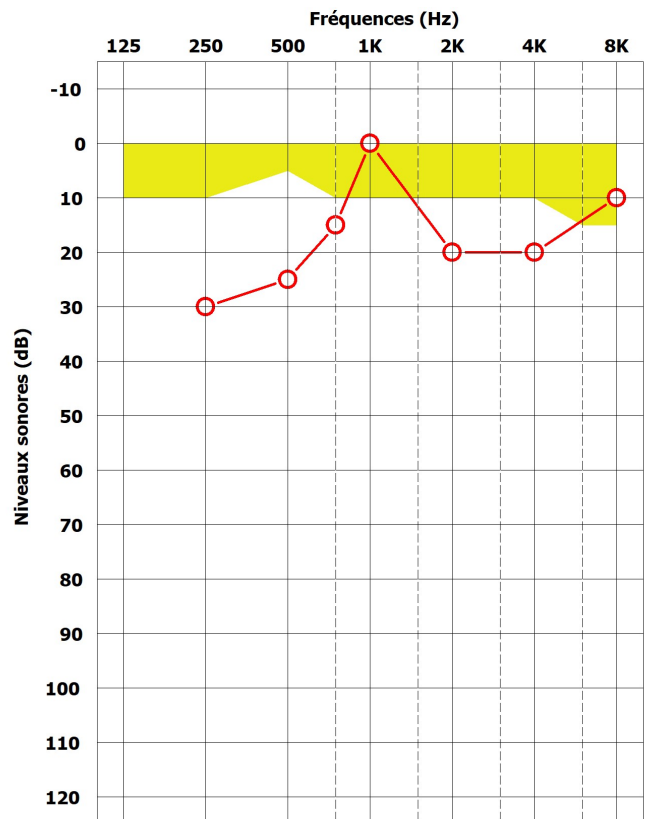

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	35	20	5		10		20		5
CA Droit		30	25	15	0		20		20		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes