

MEDVIE

Date du test: 27/02/2024 16:43:32

Durée: 11mn 36s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient **CAMARARA SAMOUKA**

Date de naissance 01/01/1992

Age 32

Société GPC


ID 24022716303586773

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

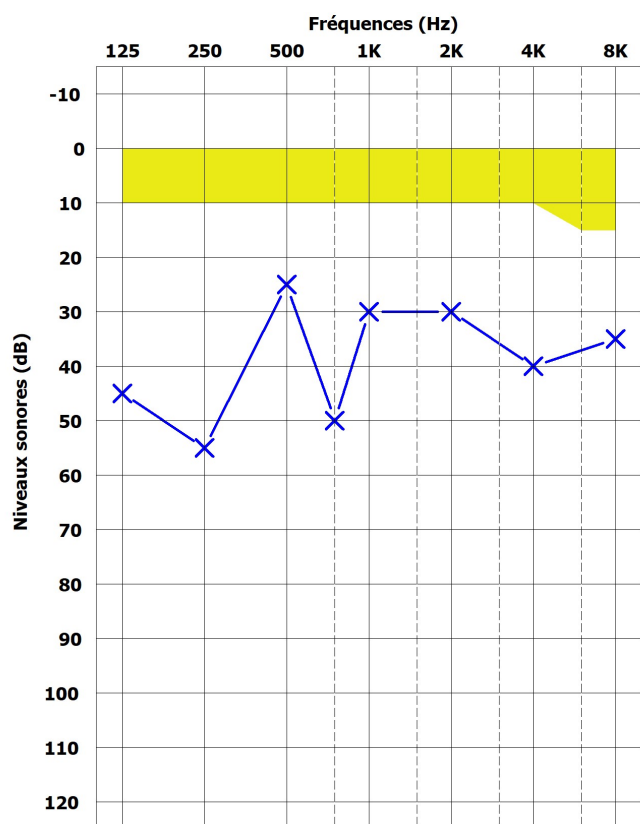

Oreille Gauche

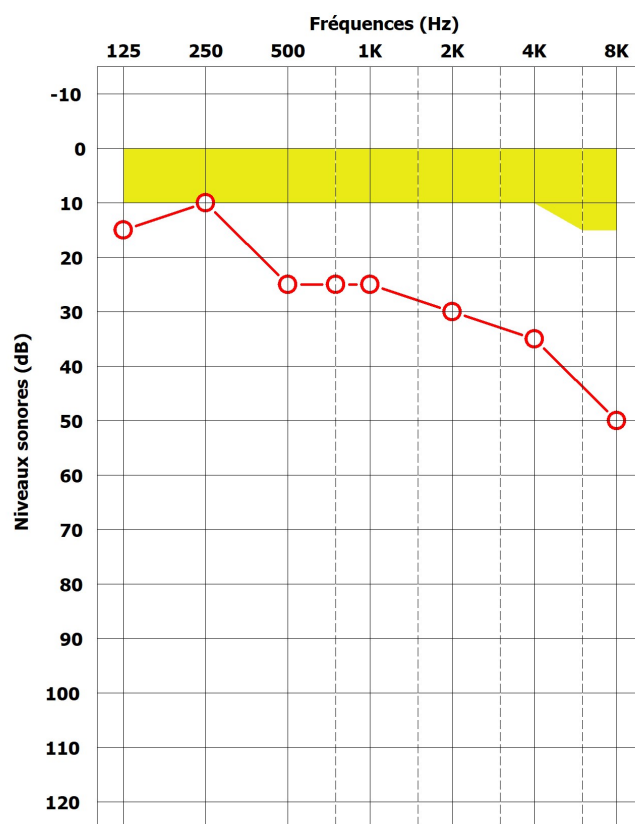

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	45	55	25	50	30		30		40		35
CA Droit	15	10	25	25	25		30		35		50

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	31,3 dB	---
CA Droit	28,8 dB	---

Notes