

Données Patient


SANDEN IBRAHIMA

Date de naissance 08/08/1973
Age 50
Société MV/GPC/125
ID 24031214231720756


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 12/03/2024 14:26:03
Durée: 5mn 47s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

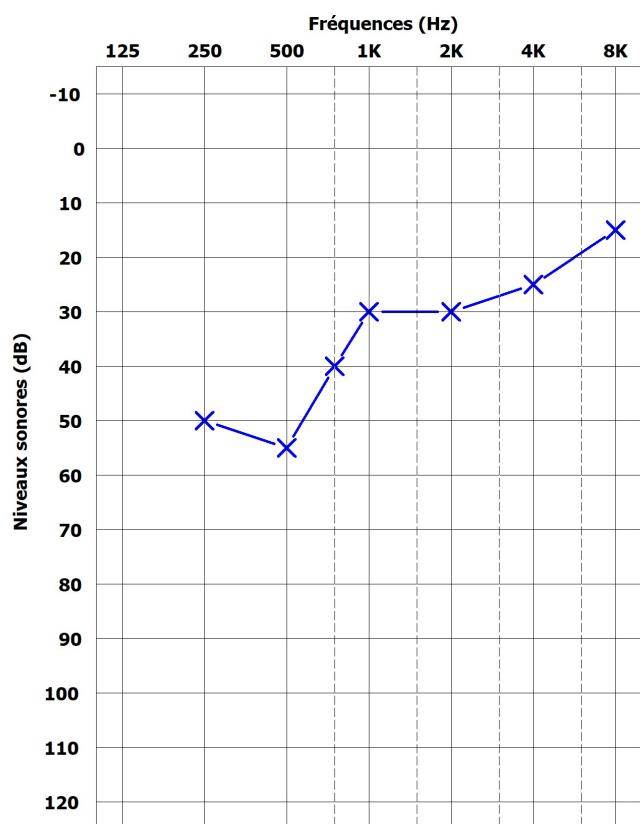

Oreille Gauche

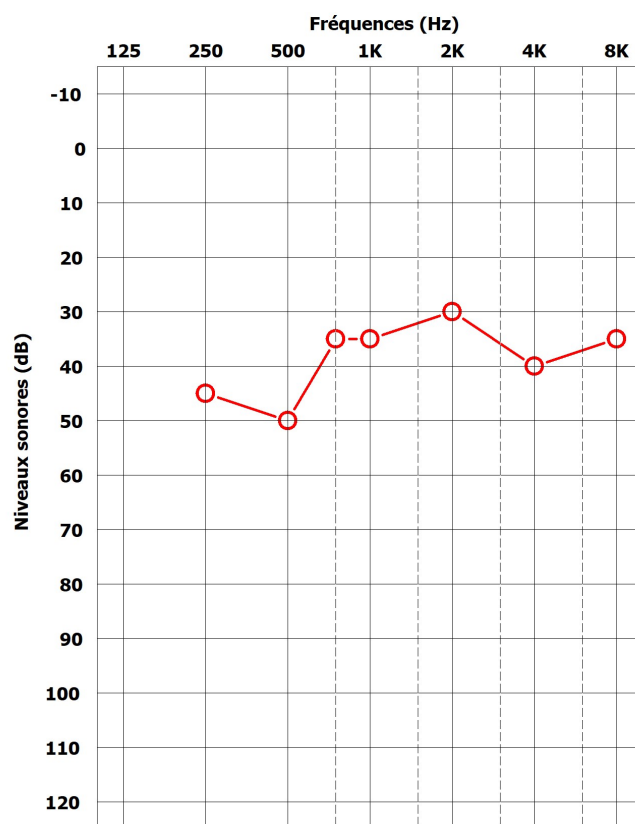

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		50	55	40	30		30		25		15
CA Droit		45	50	35	35		30		40		35

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	35,0 dB	---
CA Droit	38,8 dB	---

Notes