



Données Patient

SYLLA ABDOUL KADER

Date de naissance

01/01/1990

Age

34

Société

MV/GPC/118

ID

24031214341329092

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211


Numéro de série:

2111EAT690092


Date Calibration :

30/11/2021

Date du test: 12/03/2024 14:37:10
Durée: 5mn 52s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

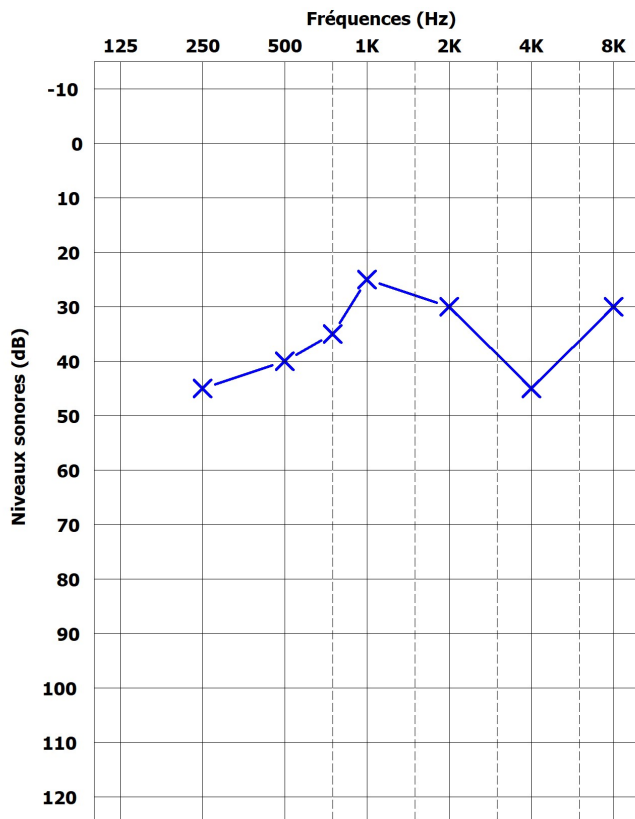

Oreille Gauche

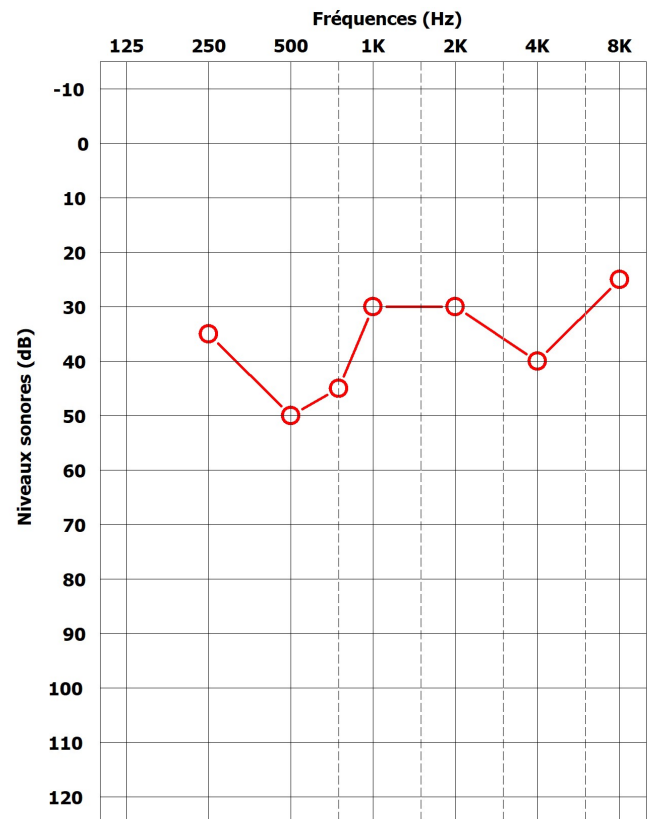

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		45	40	35	25		30		45		30
CA Droit		35	50	45	30		30		40		25

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	35,0 dB	---
CA Droit	37,5 dB	---

Notes