

MEDVIE

Date du test: 24/07/2025 10:16:16

Durée: 4mn 59s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

CHERIF MOHAMED

Date de naissance 22/03/1983

Age 42

Société GPC


ID 25072410142712169

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

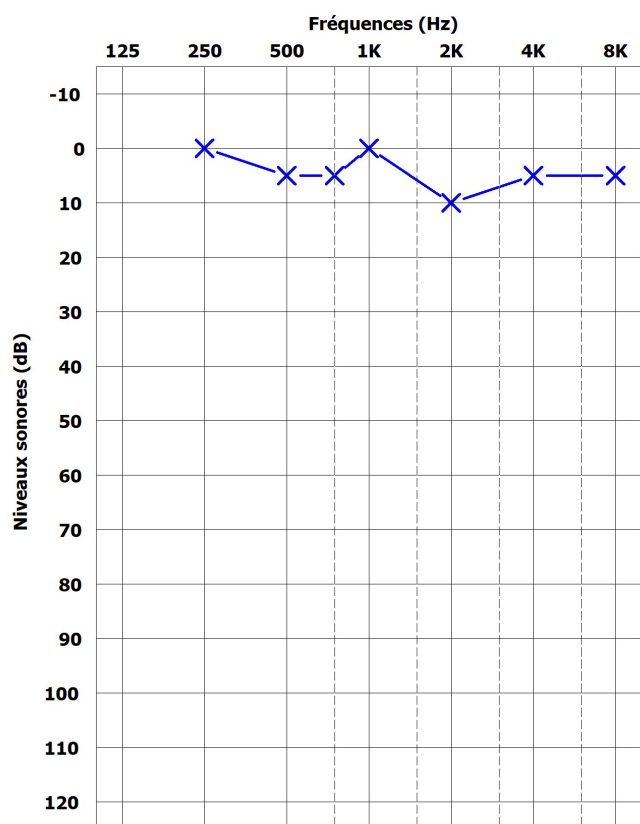

Oreille Gauche

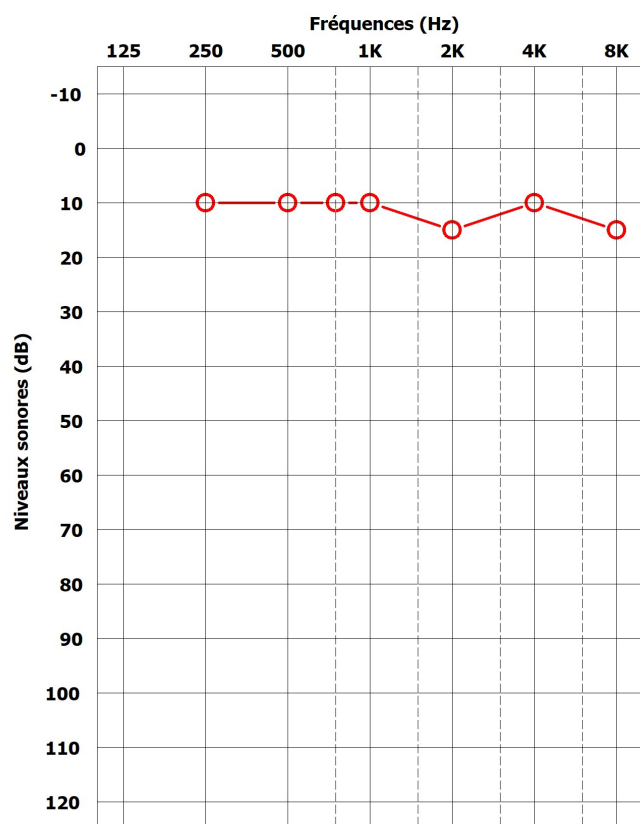

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	5	5	0		10		5		5
CA Droit		10	10	10	10		15		10		15

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes